
Pile Dynamics Inc
Transducer 691W

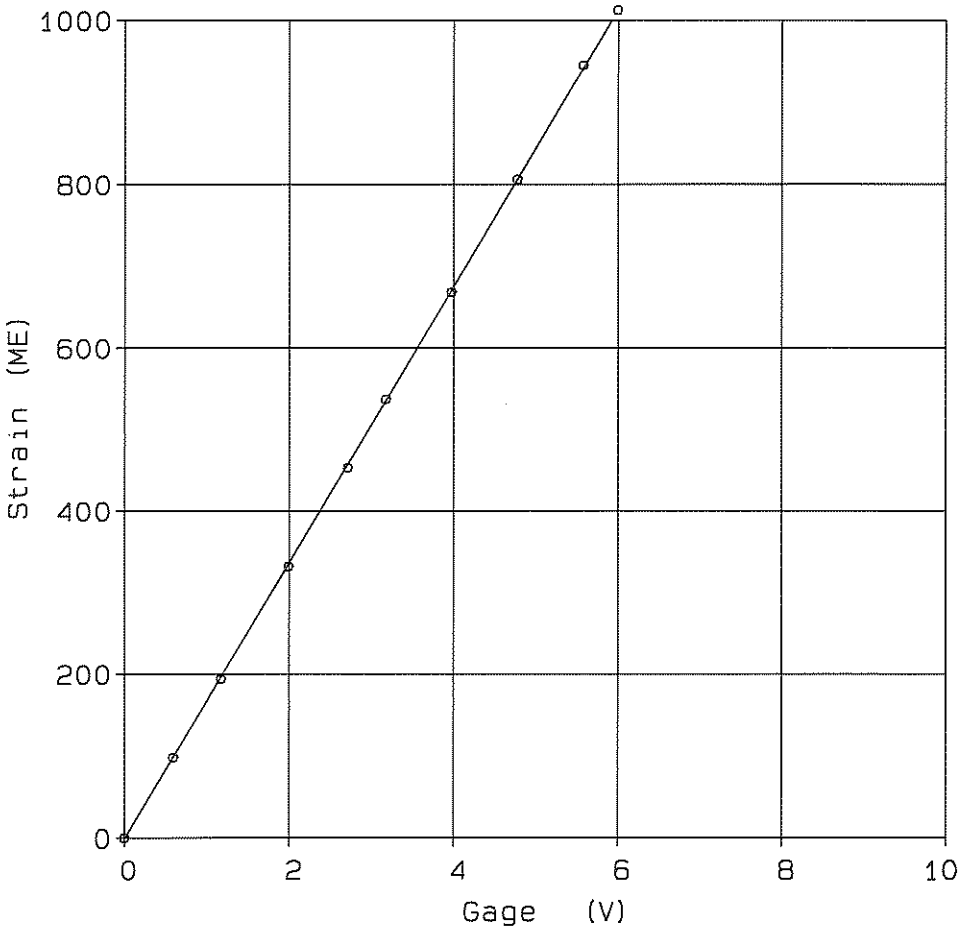

PDA Cal Factor = 169.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 587.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
98	.60
195	1.17
333	1.99
454	2.71
538	3.18
669	3.98
807	4.78
945	5.57
1013	5.99
1143	6.78

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 28-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2