Pile Dynamics Inc
Transducer 692W

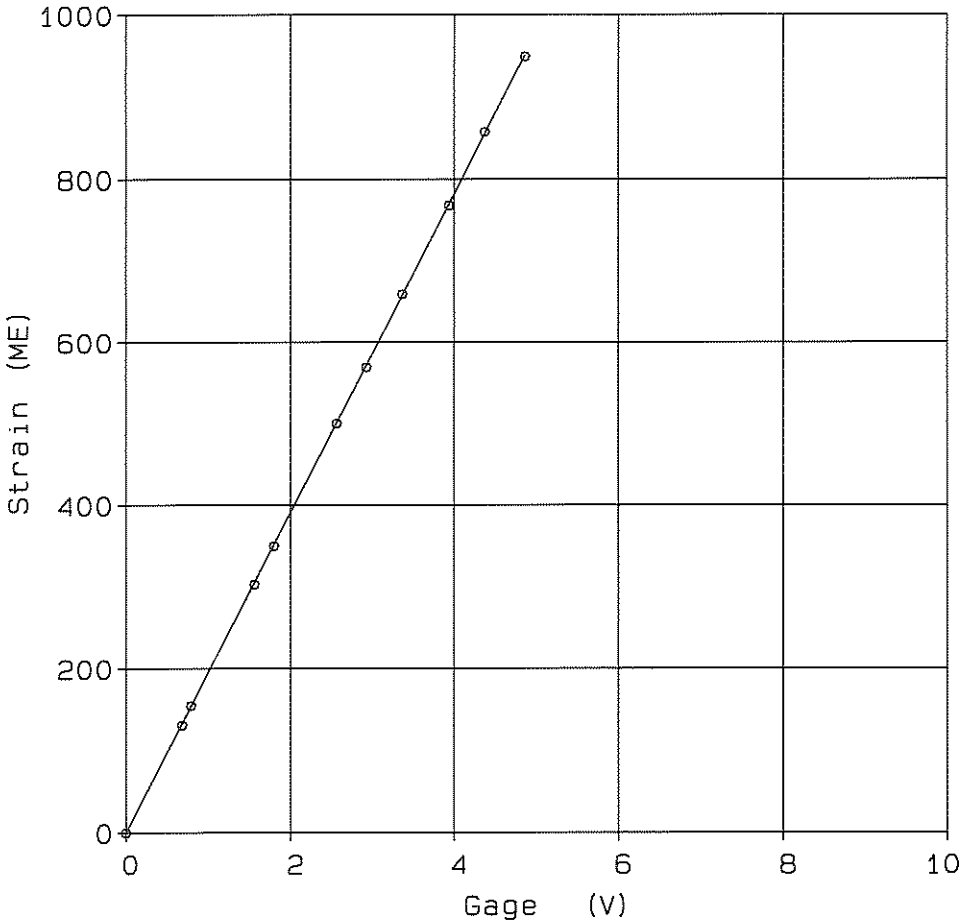

PDA Cal Factor = 195.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 680.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
131	.68
155	.79
303	1.56
351	1.81
500	2.56
570	2.92
660	3.37
769	3.94
857	4.37
950	4.87

Calibrated by: J. Rentsch

Calibrated on: 28-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2