Pile Dynamics Inc

Transducer 693W

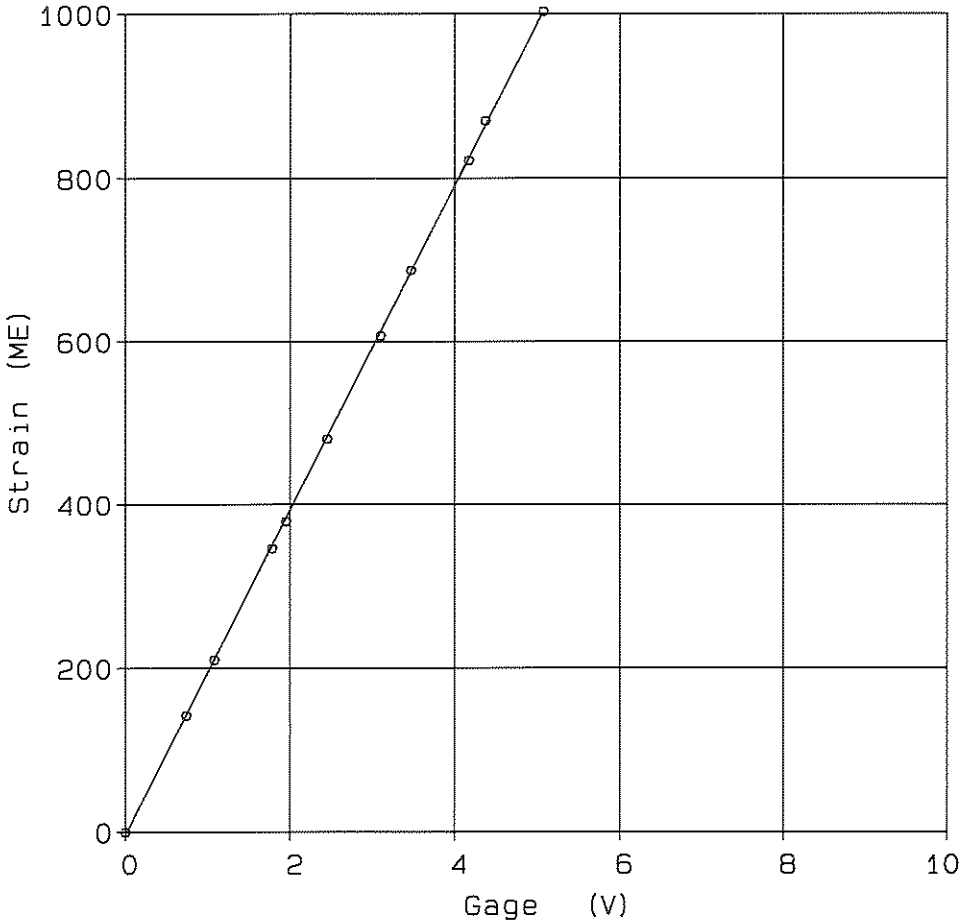

PDA Cal Factor = 198.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 689.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
143	.75
211	1.08
347	1.79
379	1.95
481	2.45
608	3.11
688	3.48
823	4.18
871	4.37
1003	5.08

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 28-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2