Pile Dynamics Inc
Transducer 700W

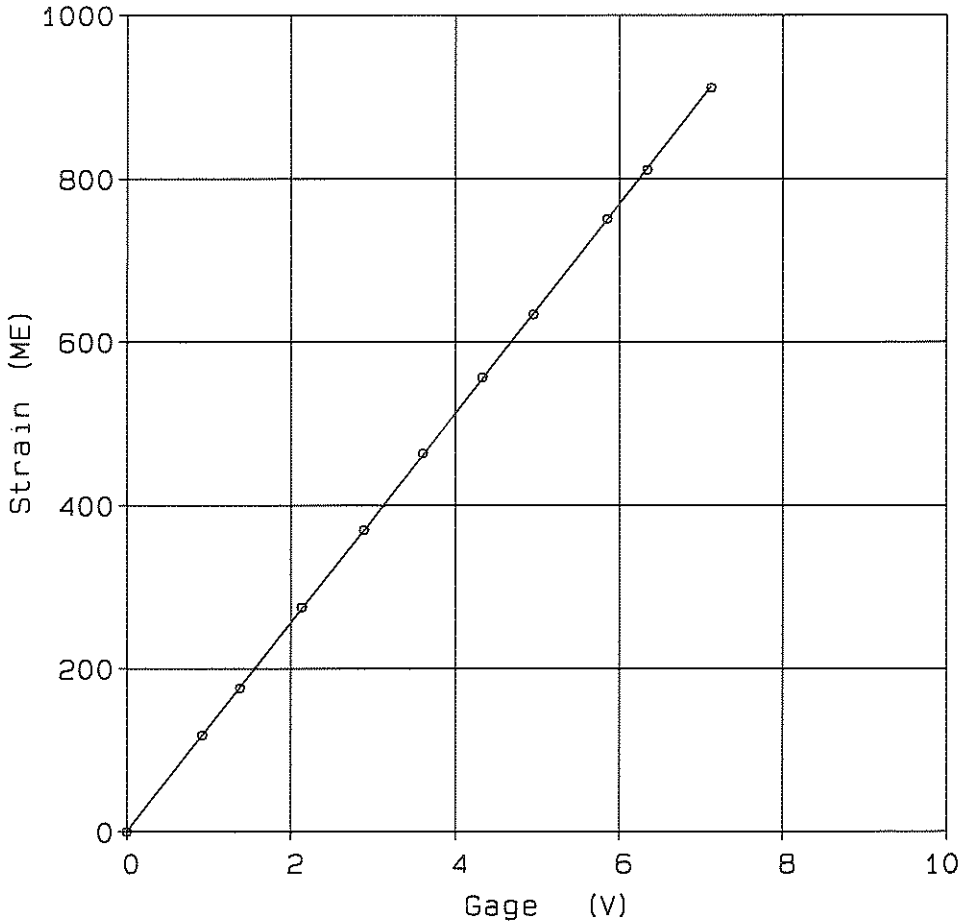

PDA Cal Factor = 128.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 444.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
119	.92
177	1.39
275	2.13
371	2.89
465	3.60
557	4.34
635	4.95
751	5.85
812	6.35
912	7.13

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-Mar-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2