Pile Dynamics Inc
Transducer 701W

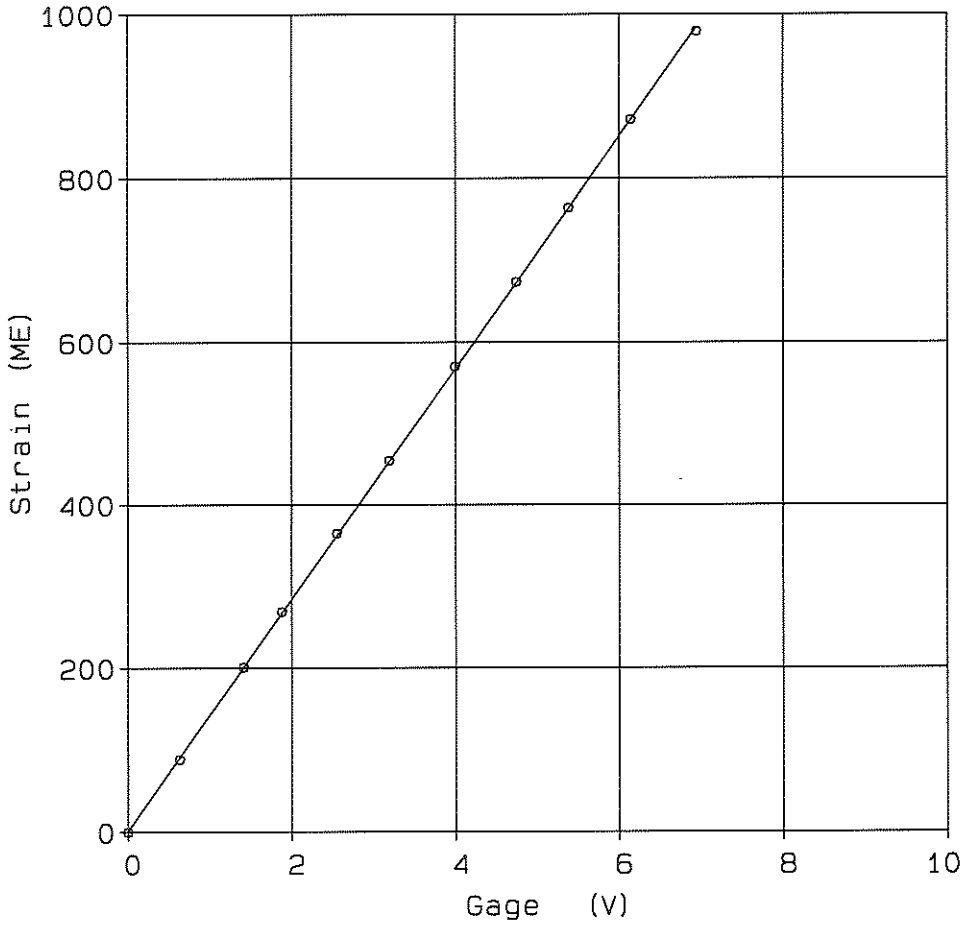

PDA Cal Factor = 141.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 491.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.64
201	1.41
270	1.89
365	2.56
455	3.19
570	3.99
674	4.74
764	5.39
872	6.14
980	6.94

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-Mar-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2