Pile Dynamics Inc
Transducer 702W

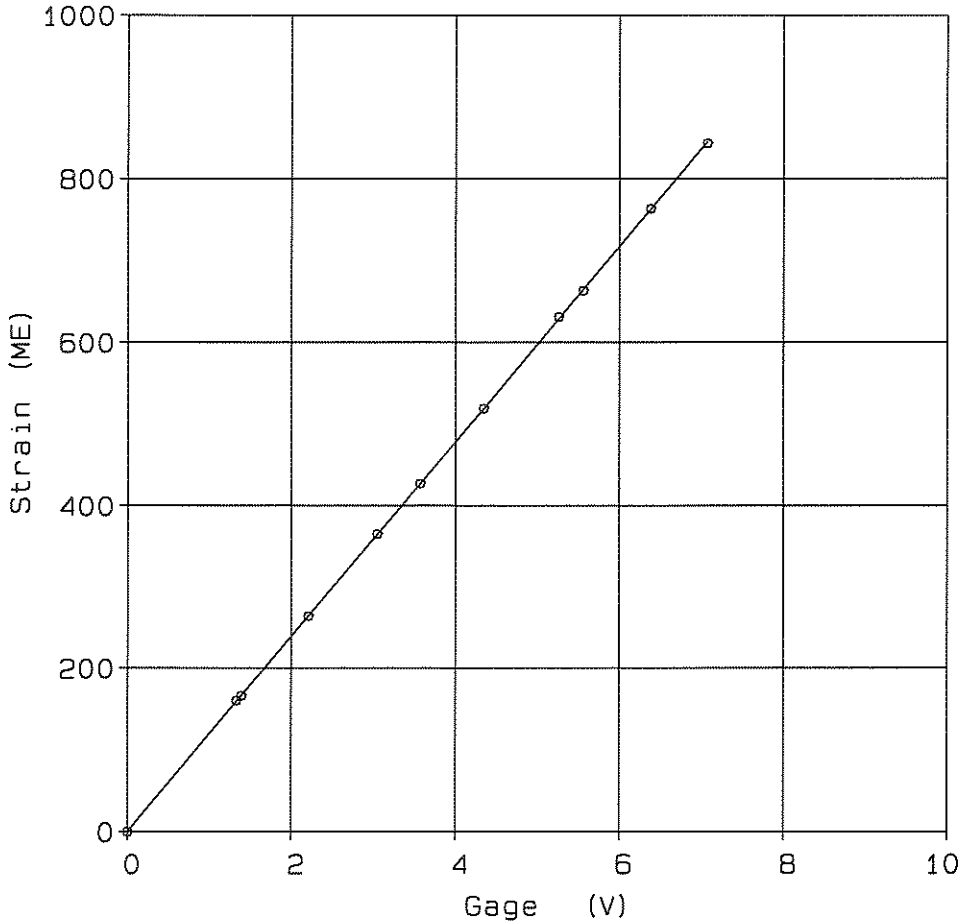

PDA Cal Factor = 119.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 414.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
161	1.33
166	1.40
265	2.22
366	3.05
428	3.57
519	4.35
631	5.27
663	5.56
764	6.39
843	7.08

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-Mar-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2