Pile Dynamics Inc
Transducer 703W

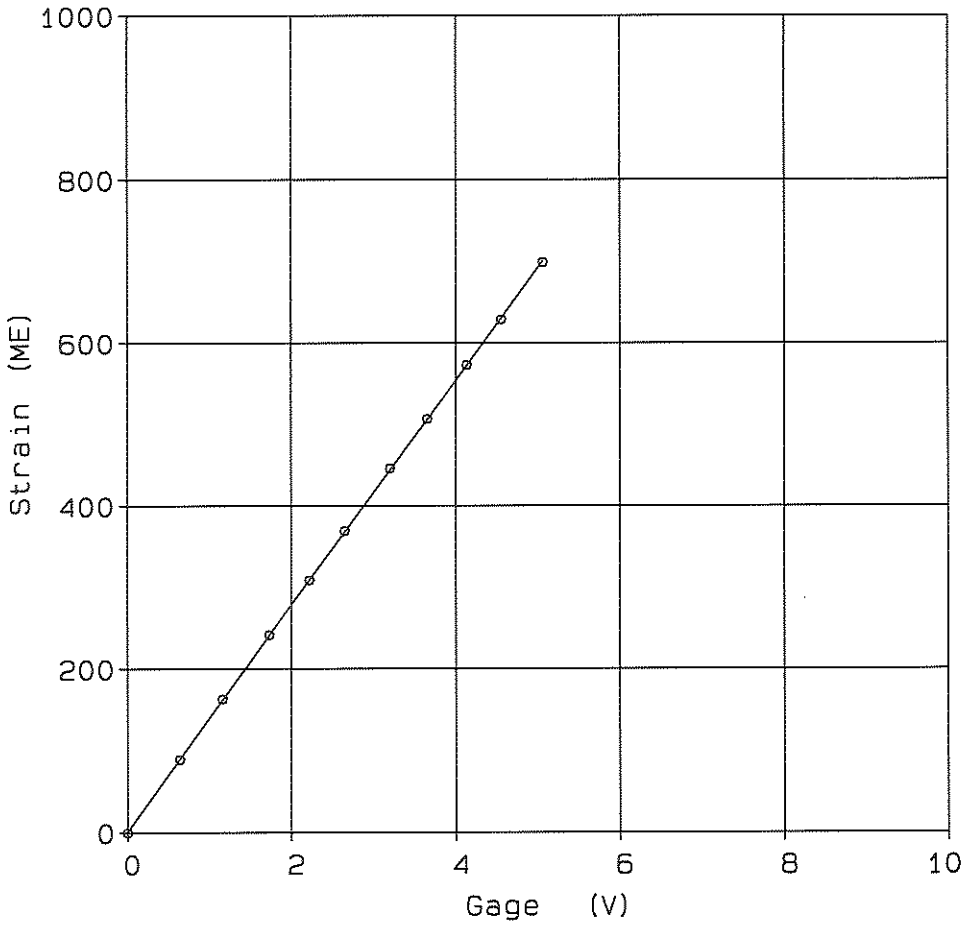

PDA Cal Factor = 138.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 480.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
90	.64
163	1.17
242	1.74
309	2.22
369	2.65
446	3.21
508	3.65
573	4.14
630	4.55
700	5.06

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2