Pile Dynamics Inc
Transducer 704W

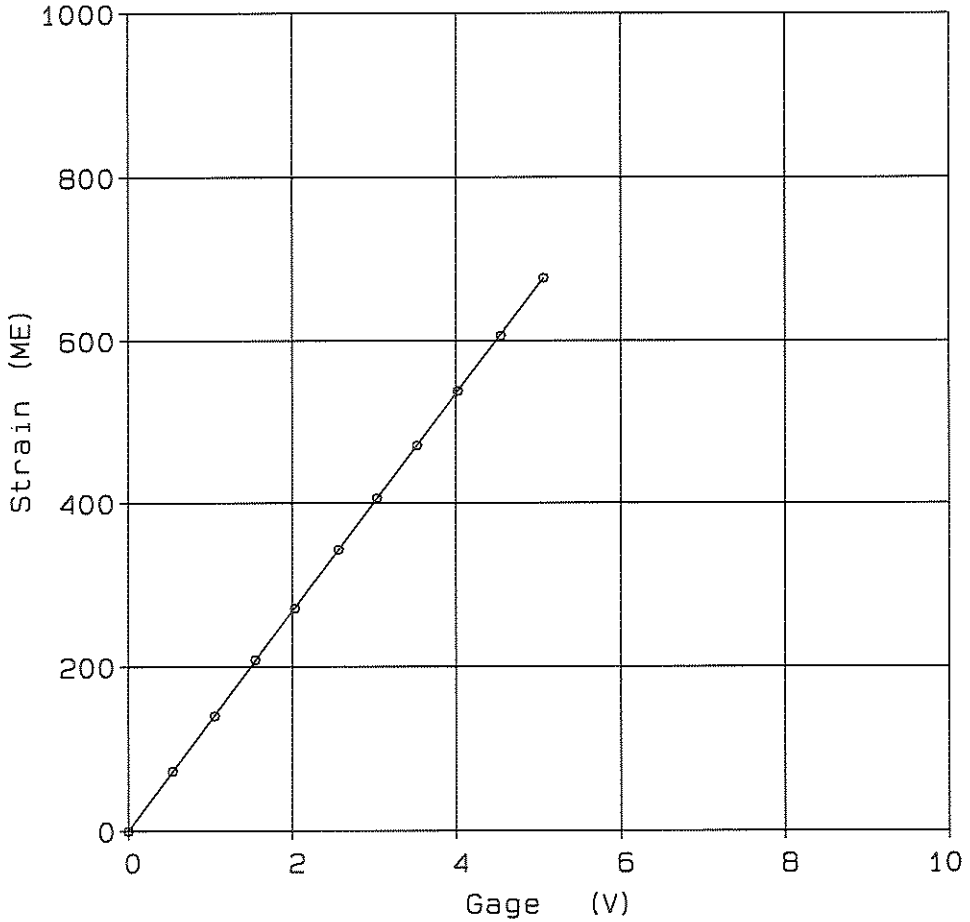

PDA Cal Factor = 133.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 464.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
73	.55
141	1.05
209	1.55
271	2.03
344	2.56
407	3.03
472	3.53
538	4.03
607	4.54
677	5.07

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2