Pile Dynamics Inc

Transducer 705W

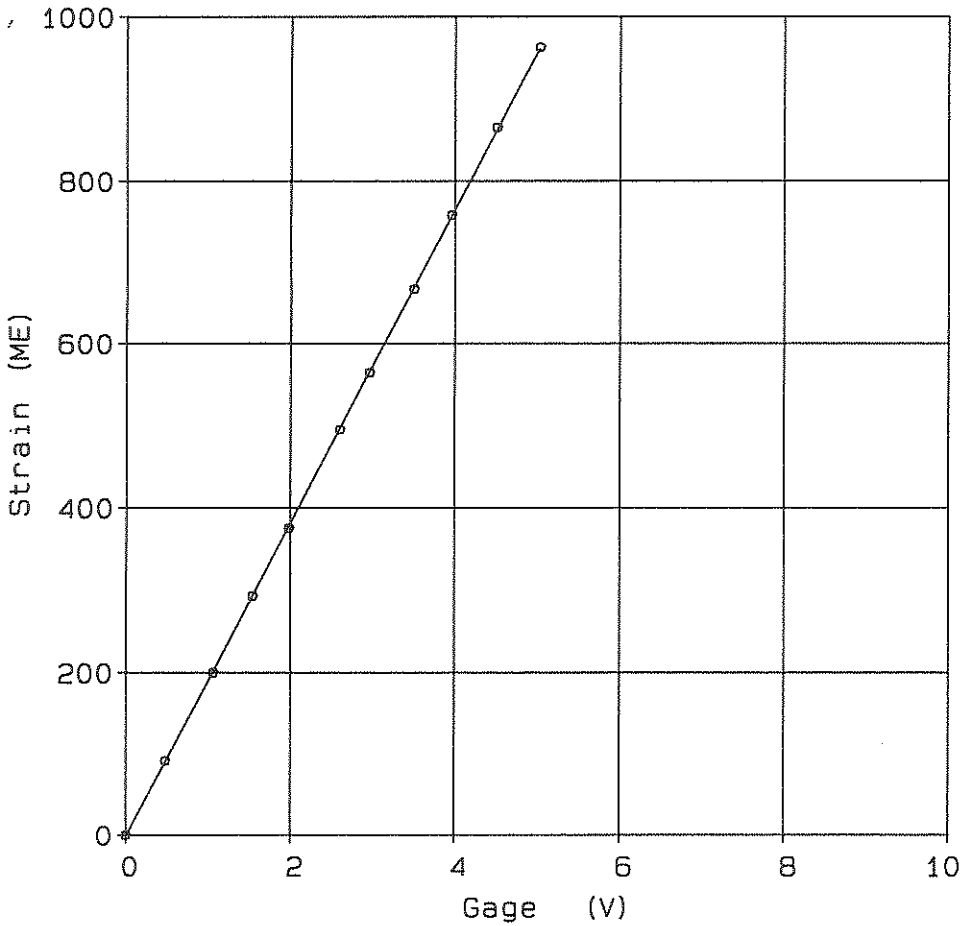

PDA Cal Factor = 191.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 666.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
92	.49
201	1.06
293	1.55
376	1.99
496	2.61
565	2.96
668	3.50
758	3.96
865	4.51
964	5.03

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 08-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2