Pile Dynamics Inc
Transducer 706W

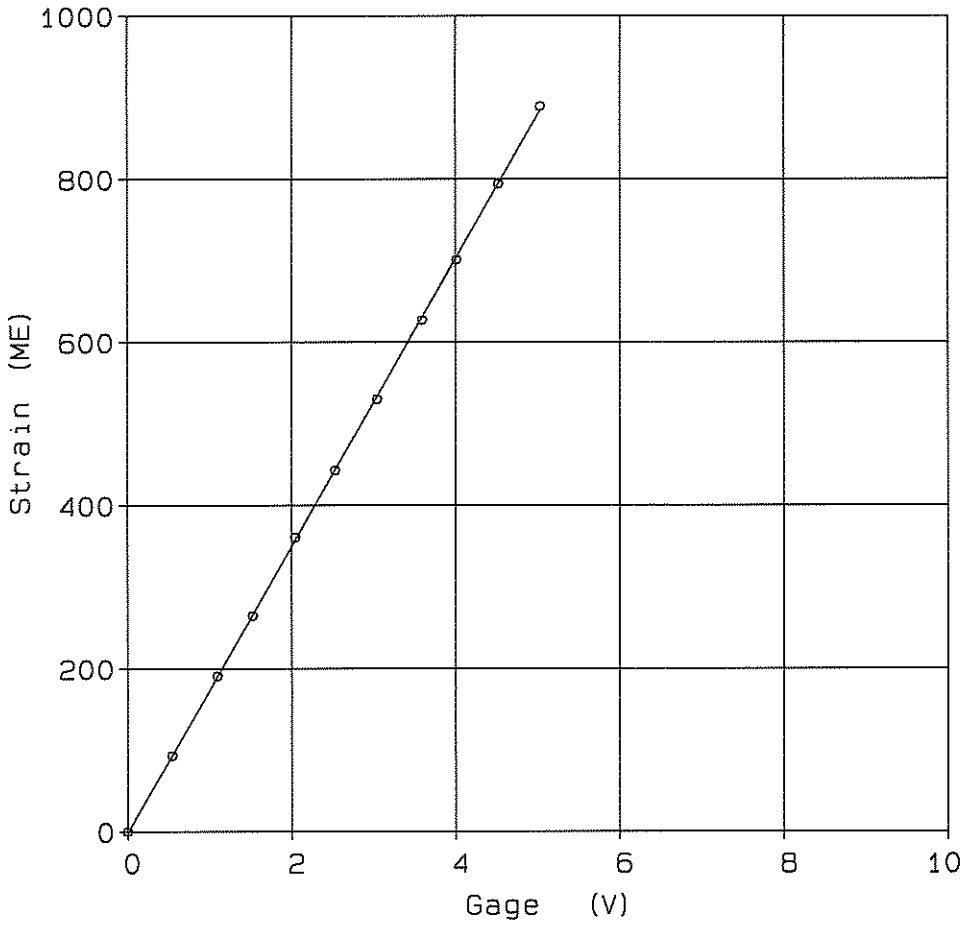

PDA Cal Factor = 175.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 610.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.54
191	1.10
265	1.52
361	2.05
444	2.54
530	3.05
628	3.60
702	4.01
794	4.52
890	5.04

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2