Pile Dynamics Inc
Transducer 707W

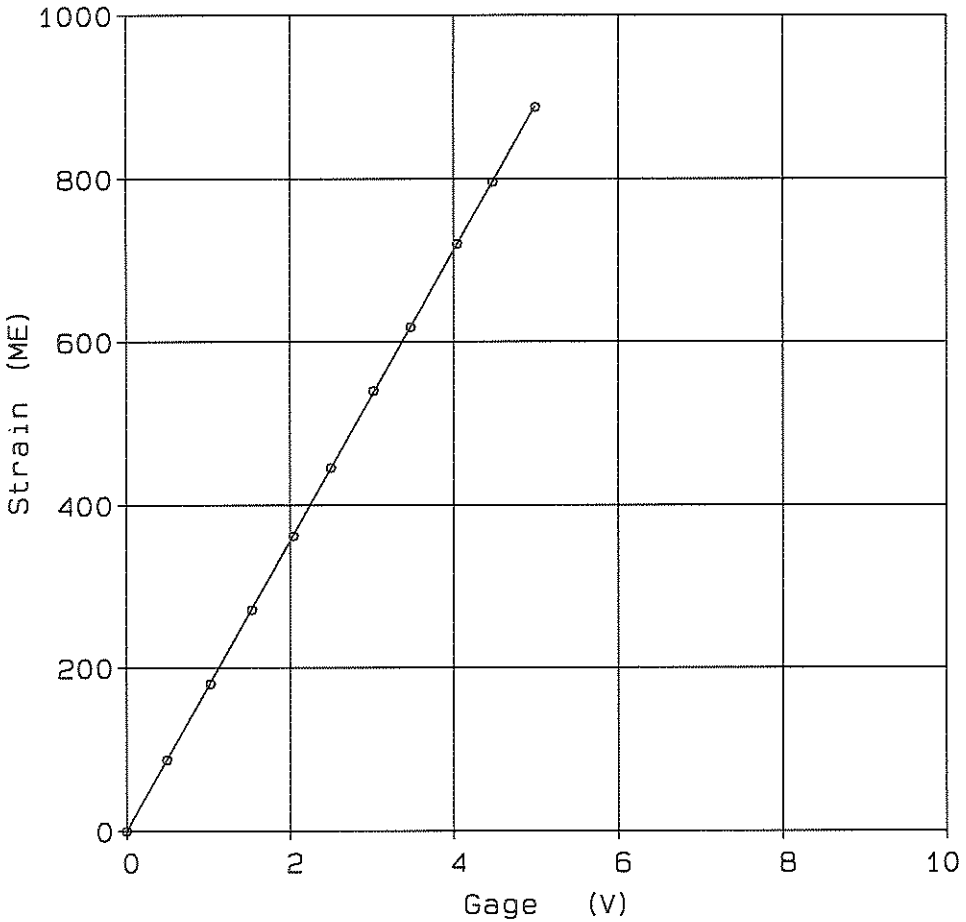

PDA Cal Factor = 178.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 618.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
87	.50
181	1.03
272	1.54
363	2.04
447	2.51
540	3.03
619	3.47
720	4.04
797	4.47
888	5.00

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2