Pile Dynamics Inc
Transducer 708W

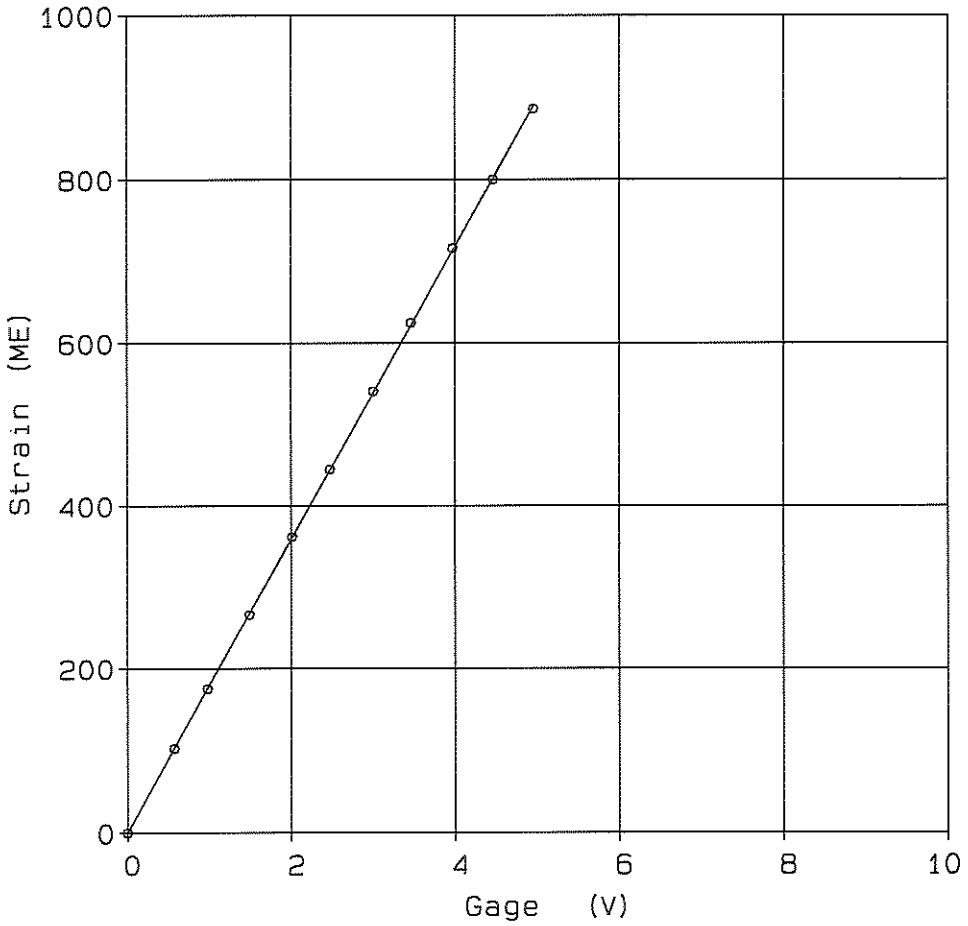

PDA Cal Factor = 179.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 623.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
102	.58
175	.98
267	1.49
363	2.02
446	2.48
542	3.01
625	3.47
716	3.98
800	4.46
886	4.95

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2