Pile Dynamics Inc
Transducer 709W

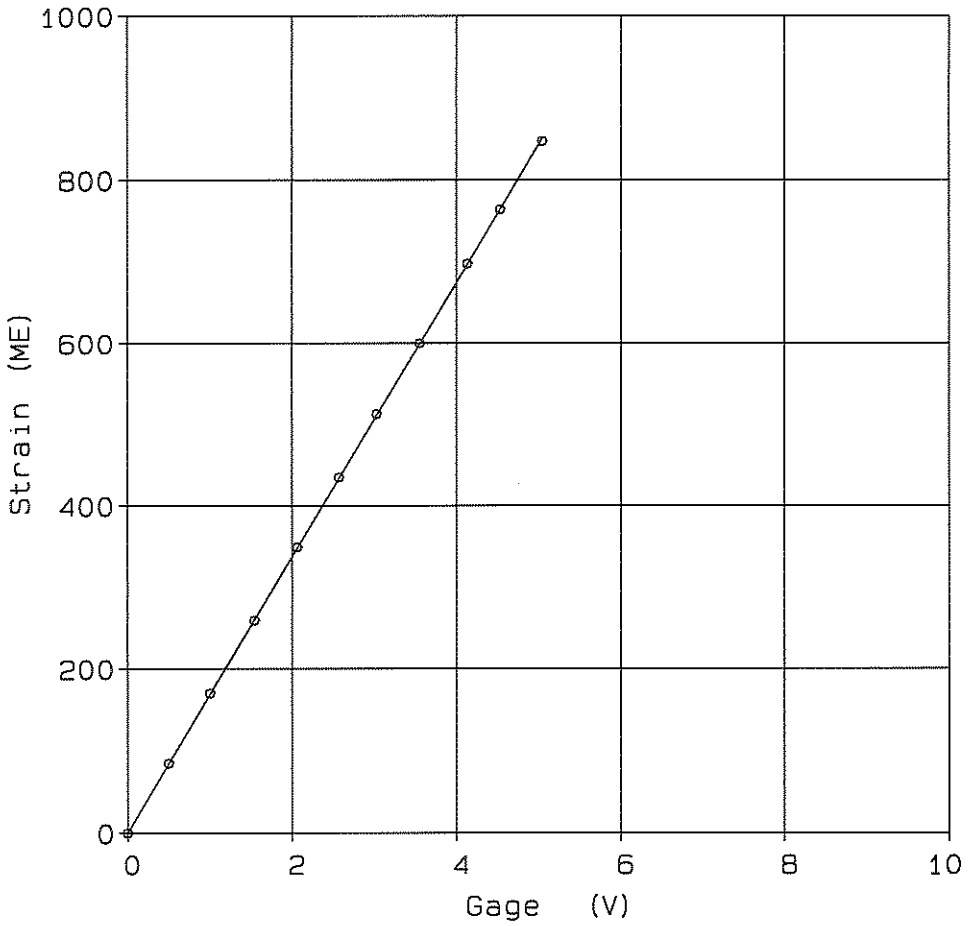

PDA Cal Factor = 168.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 584.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
86	.51
170	1.01
260	1.54
349	2.07
435	2.57
513	3.03
601	3.55
699	4.14
765	4.54
847	5.05

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2