Pile Dynamics Inc
Transducer 712W

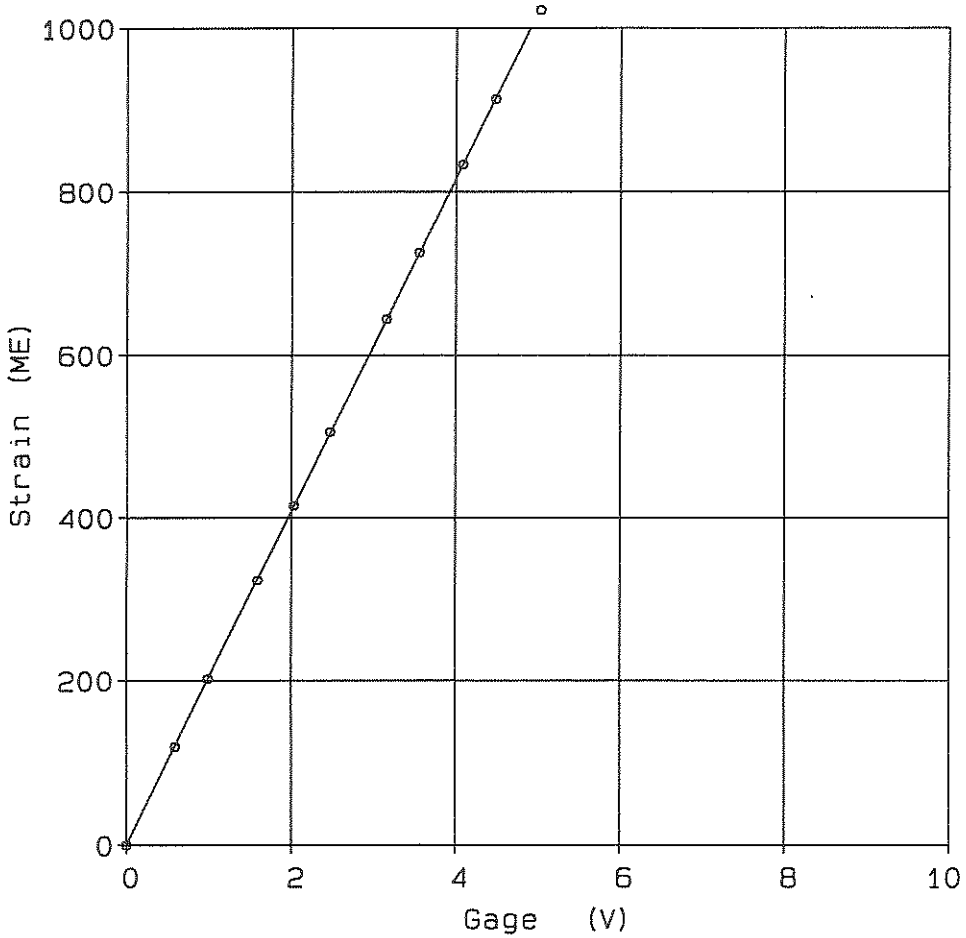

PDA Cal Factor = 203.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 707.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
120	.59
202	1.00
324	1.59
415	2.04
506	2.48
645	3.16
726	3.55
833	4.09
913	4.48
1022	5.03

Calibrated by: _____

Calibrated on: 08-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2