Pile Dynamics Inc

Transducer 713W

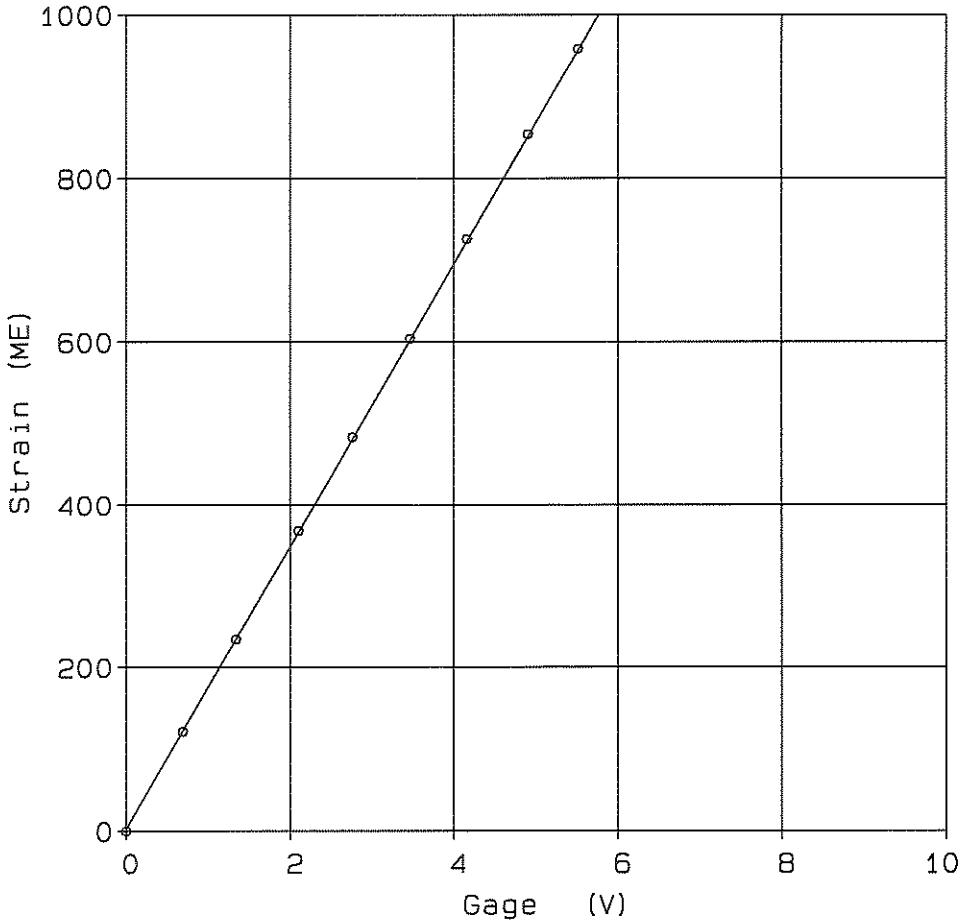

PDA Cal Factor = 173.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 600.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
121	.70
235	1.35
369	2.11
483	2.76
605	3.47
726	4.16
854	4.90
960	5.52
1079	6.23
1205	6.99

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2