Pile Dynamics Inc

Transducer 714W

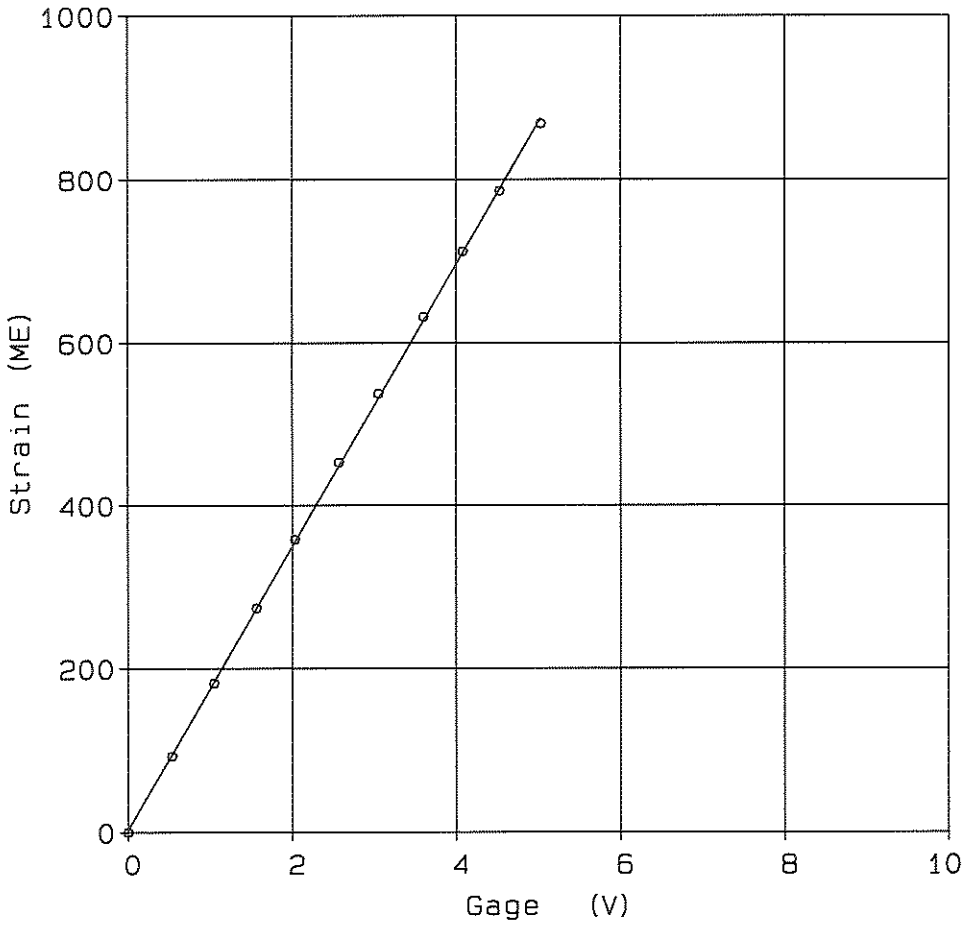

PDA Cal Factor = 173.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 601.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.53
183	1.04
274	1.56
358	2.03
454	2.58
539	3.06
632	3.61
713	4.08
786	4.54
869	5.03

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2