# Pile Dynamics Inc
# Transducer 716W

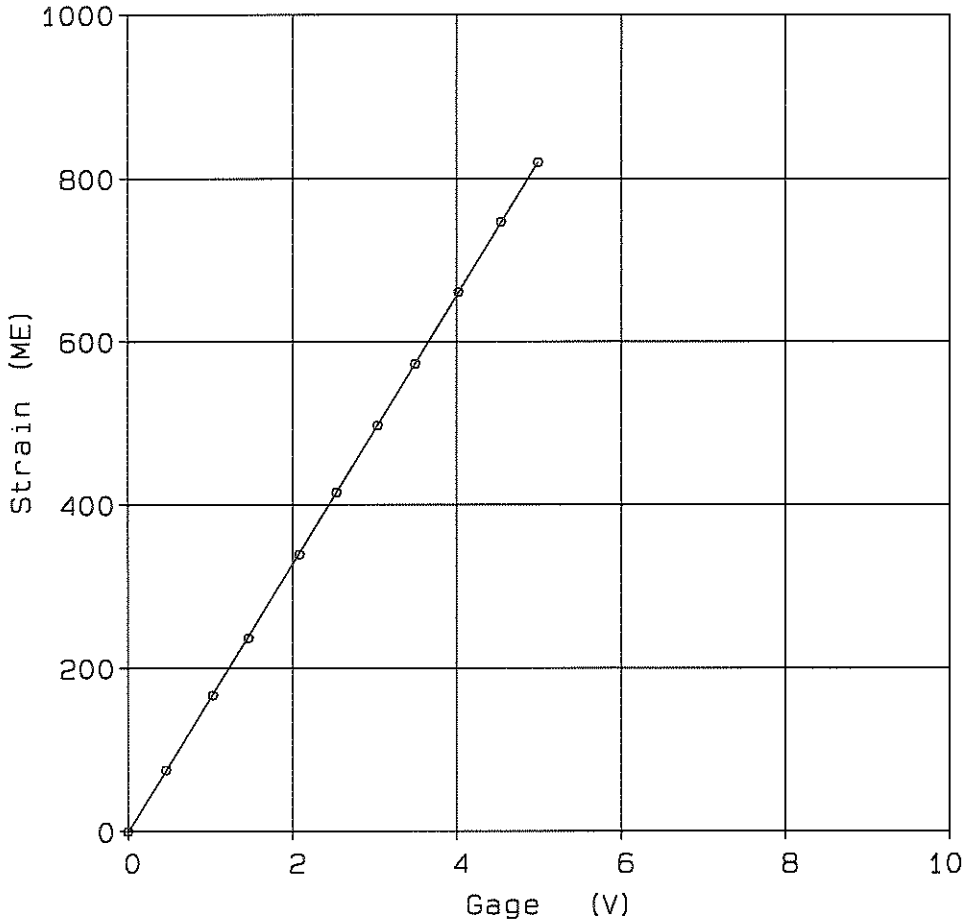


PDA Cal Factor = 164.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 571.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 75 | .47 |
| 167 | 1.03 |
| 237 | 1.47 |
| 340 | 2.09 |
| 415 | 2.54 |
| 497 | 3.03 |
| 574 | 3.49 |
| 661 | 4.02 |
| 747 | 4.54 |
| 820 | 5.00 |

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2