Pile Dynamics Inc

Transducer 718W

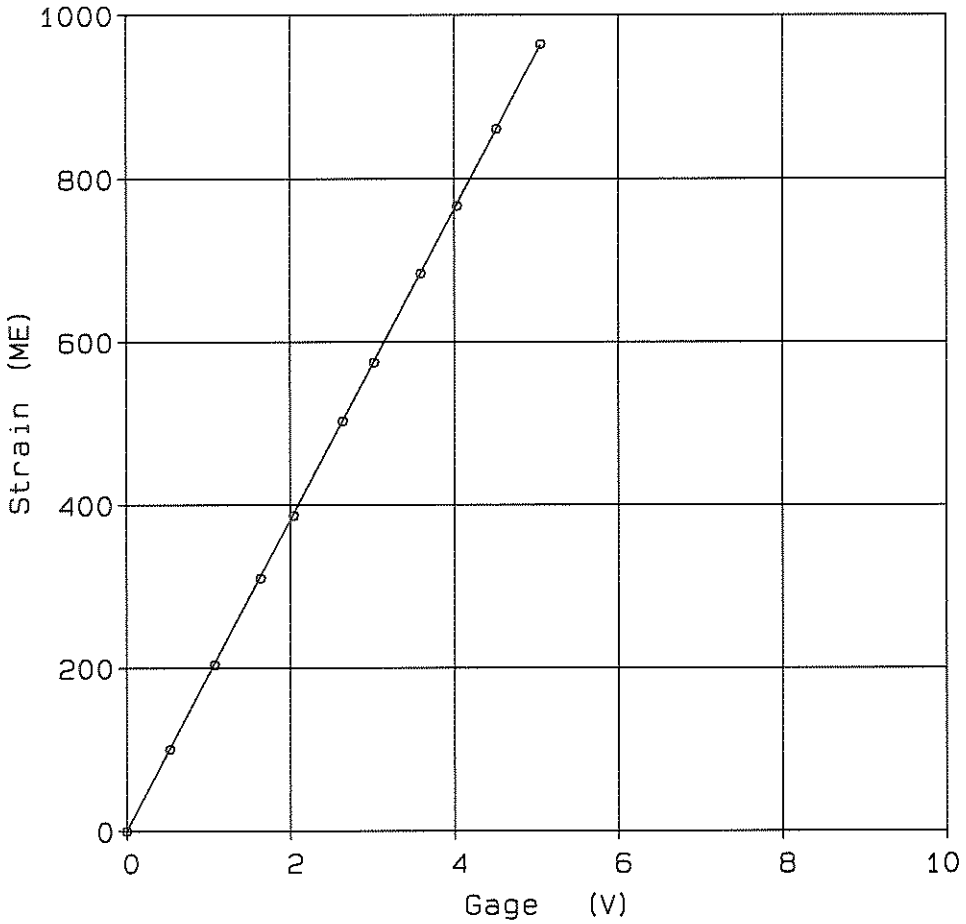

PDA Cal Factor	=	191.0 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	663.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
100	.53
205	1.09
311	1.64
388	2.04
504	2.65
576	3.02
684	3.60
767	4.03
862	4.51
965	5.06

Calibrated by: Fred Huggins

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2