Pile Dynamics Inc
Transducer 719W

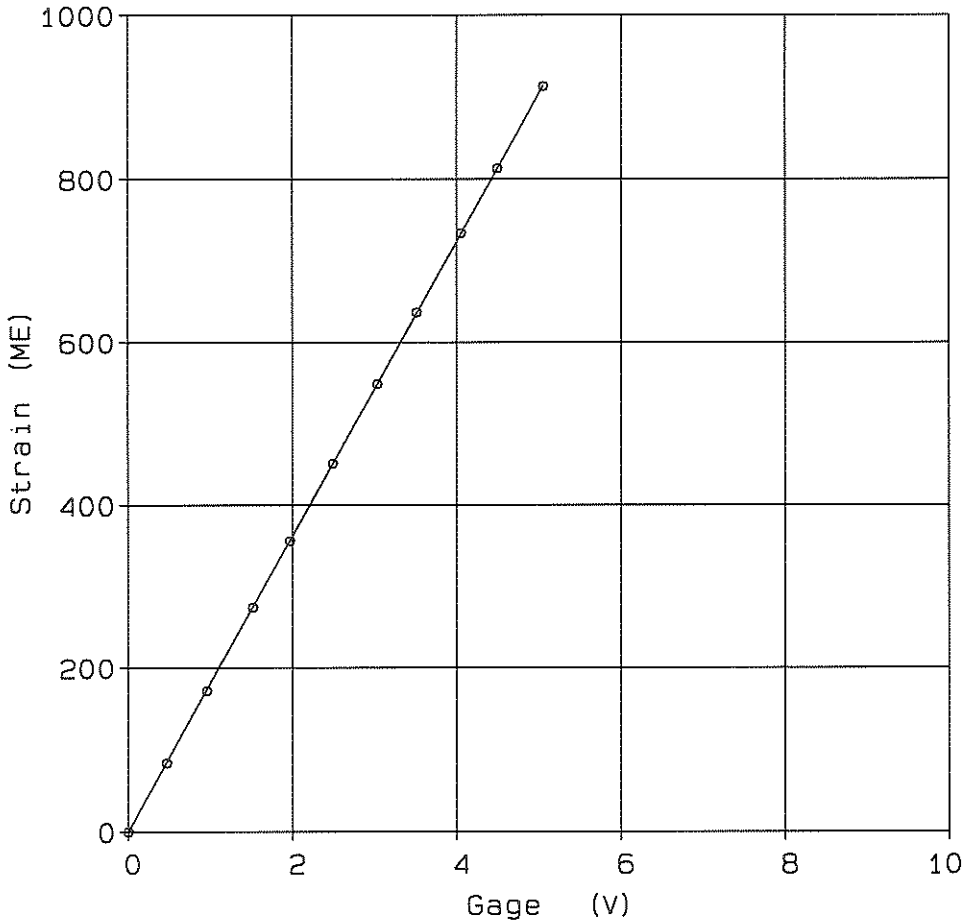

PDA Cal Factor = 181.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 629.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
85	.47
173	.97
274	1.53
357	1.98
452	2.49
549	3.04
638	3.51
735	4.06
814	4.50
914	5.05

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2