# Pile Dynamics Inc
# Transducer 721W

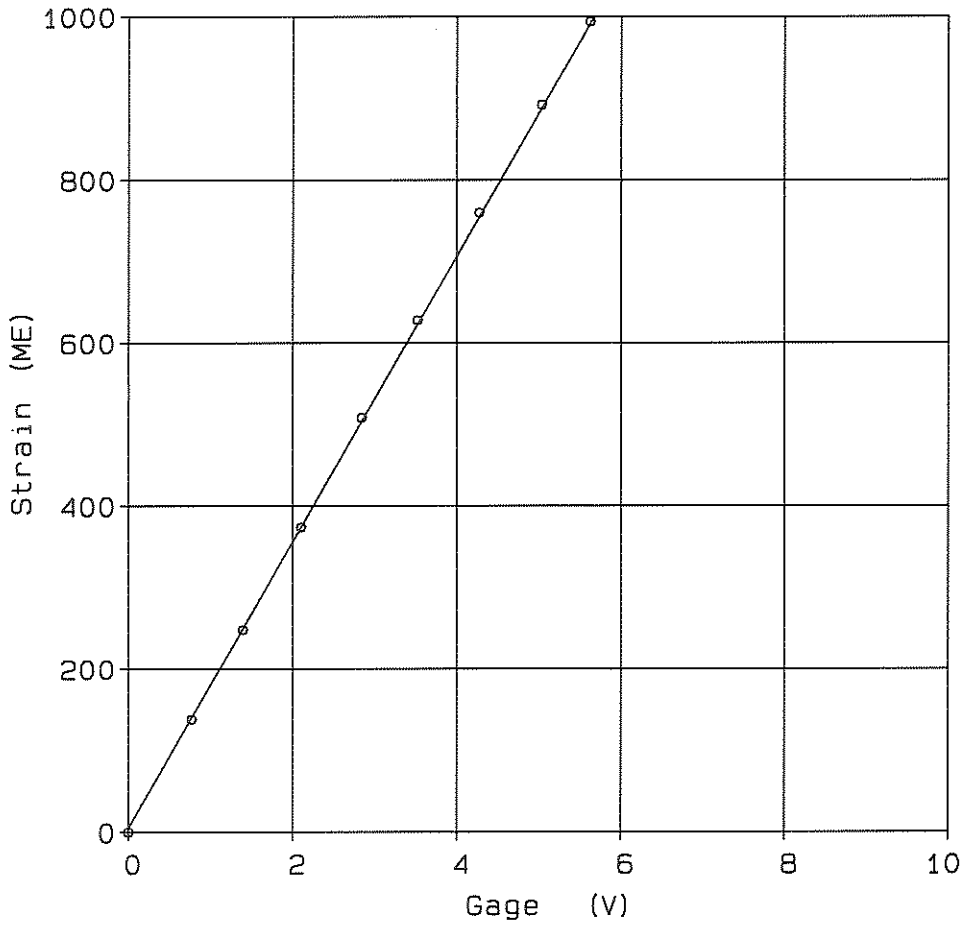


PDA Cal Factor = 175.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 609.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 139 | .78 |
| 248 | 1.39 |
| 375 | 2.10 |
| 508 | 2.85 |
| 628 | 3.52 |
| 760 | 4.28 |
| 893 | 5.04 |
| 994 | 5.62 |
| 1115 | 6.34 |
| 1232 | 7.05 |

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 15-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2