Pile Dynamics Inc

Transducer 722W

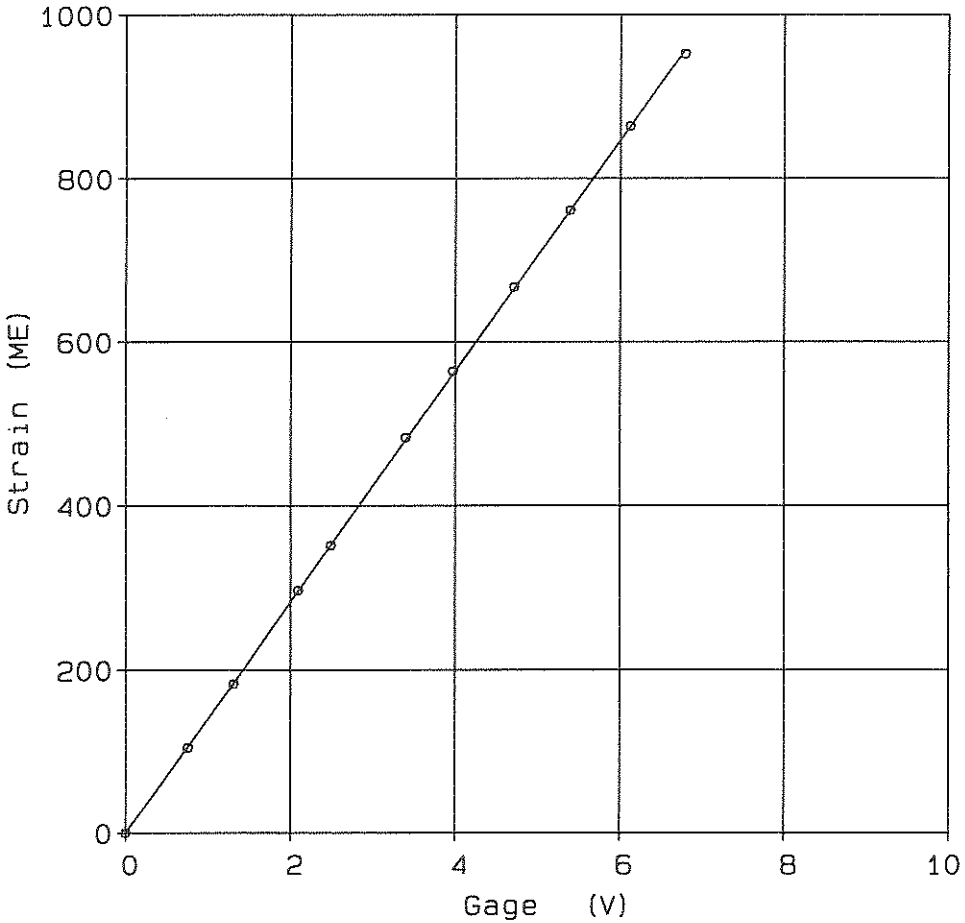

PDA Cal Factor = 140.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 489.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
106	.75
184	1.31
297	2.09
352	2.50
483	3.40
564	3.98
668	4.71
761	5.40
865	6.13
954	6.79

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2