Pile Dynamics Inc

Transducer 723W

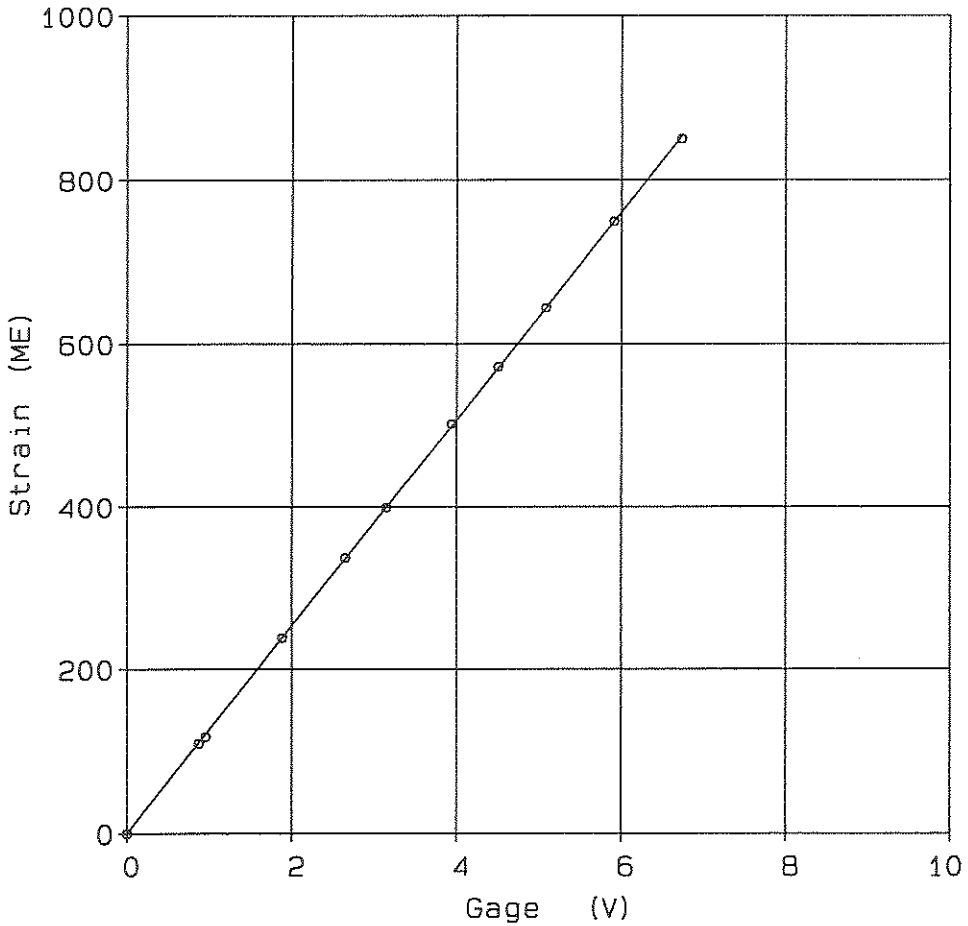

PDA Cal Factor = 126.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 440.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
110	.87
118	.95
238	1.88
337	2.65
399	3.15
502	3.95
573	4.51
644	5.08
750	5.91
850	6.73

Calibrated by: J. Rowtoff

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2