Pile Dynamics Inc

Transducer 724W

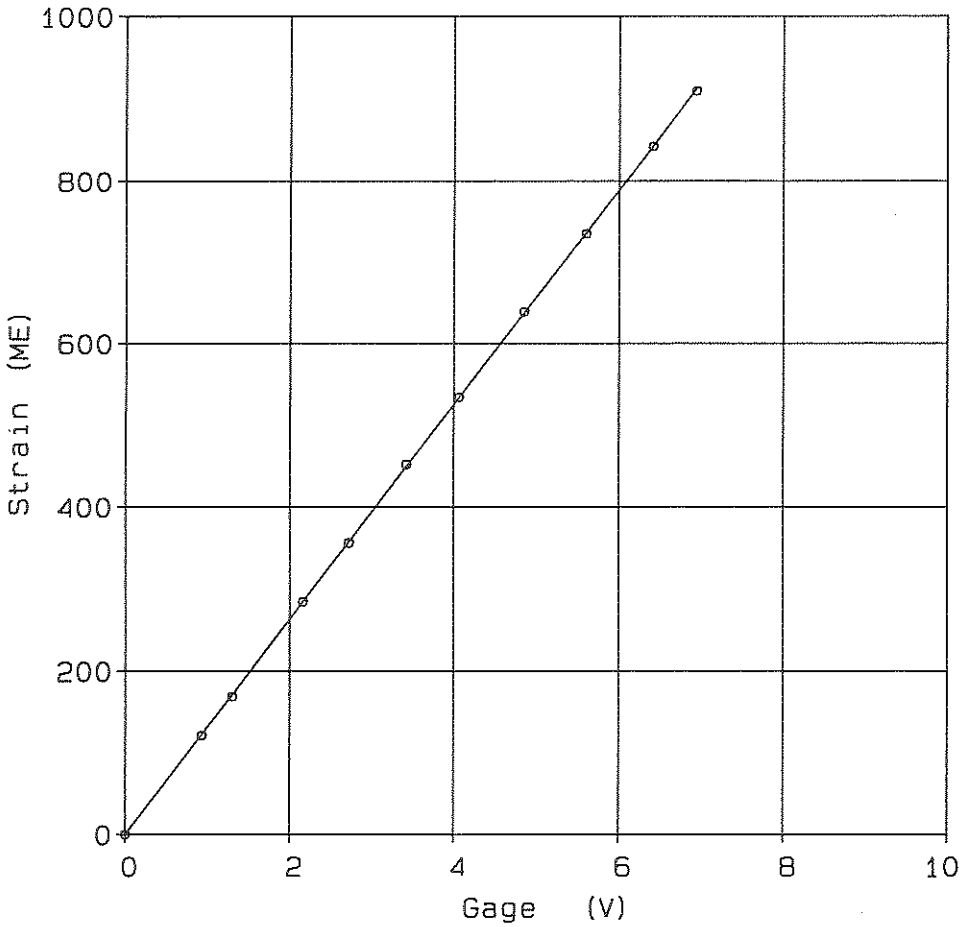

PDA Cal Factor = 131.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 456.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
121	.93
169	1.30
285	2.17
357	2.73
452	3.43
534	4.07
640	4.86
736	5.60
843	6.42
909	6.95

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2