Pile Dynamics Inc

Transducer 725W

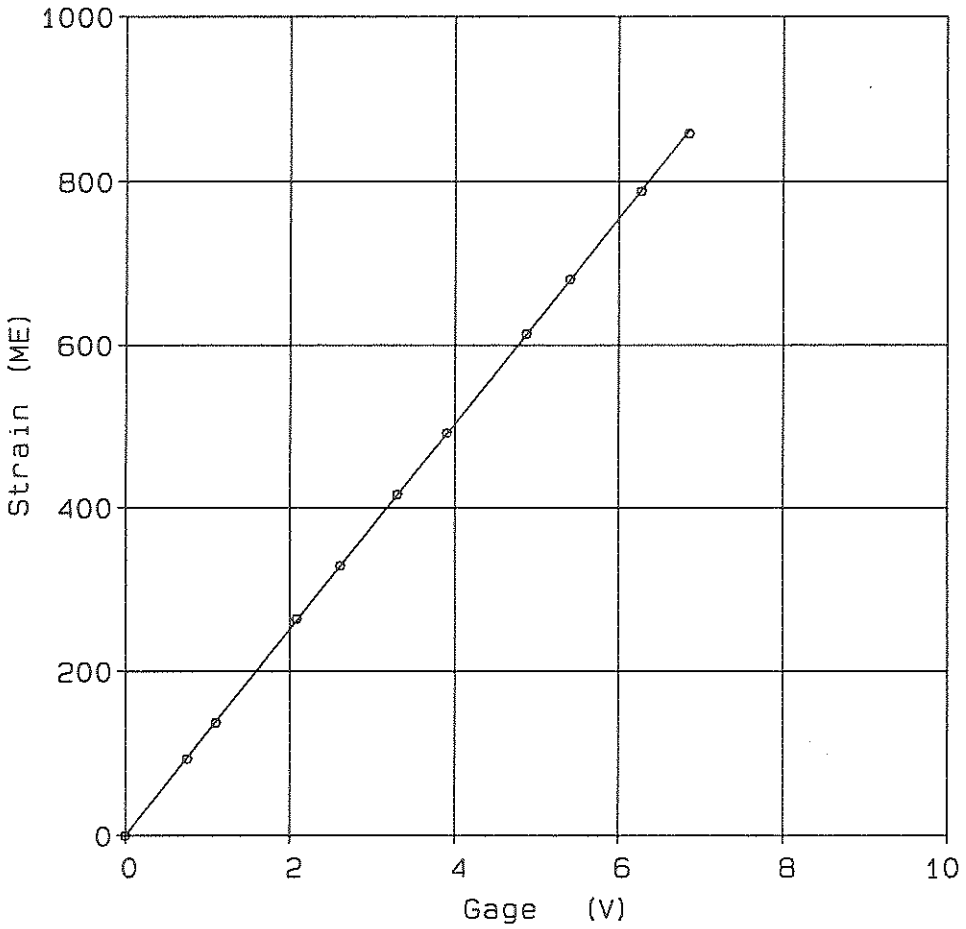

PDA Cal Factor = 125.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 436.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.75
137	1.11
264	2.09
329	2.62
417	3.30
493	3.90
614	4.87
681	5.41
789	6.28
859	6.86

Calibrated by: J. C. Deutsch

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2