Pile Dynamics Inc
Transducer 726W

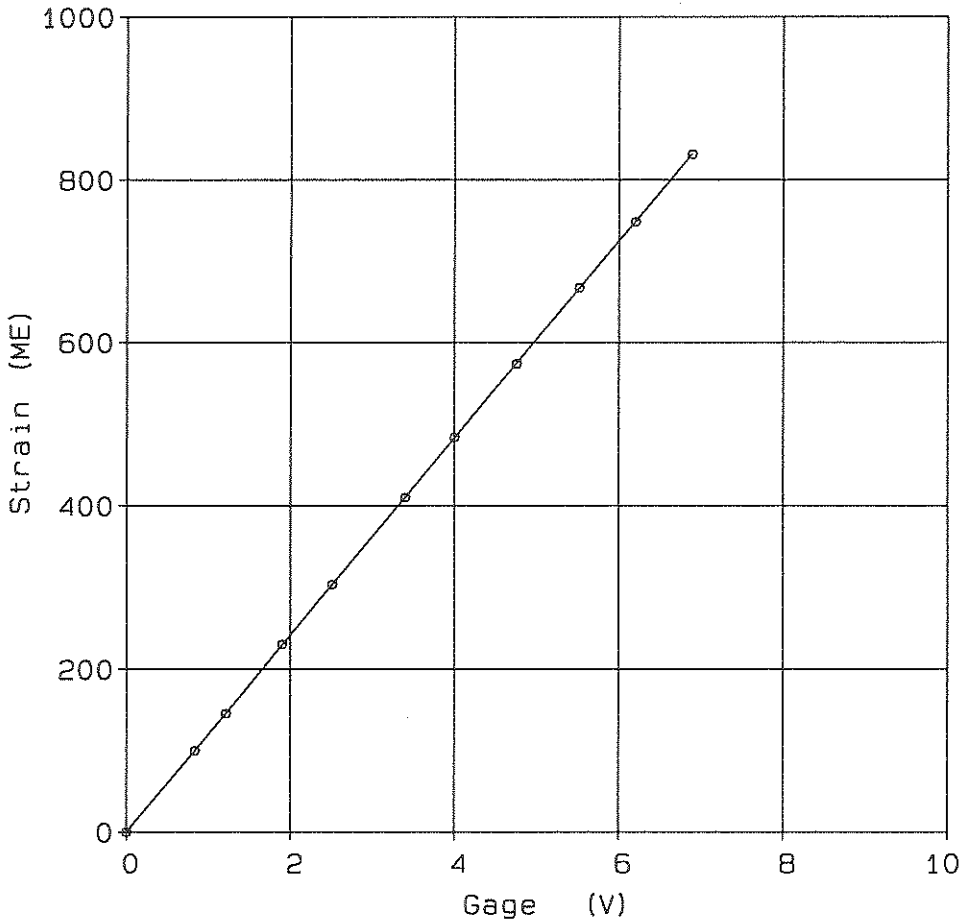

PDA Cal Factor = 120.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 419.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
100	.84
146	1.22
230	1.91
303	2.52
410	3.40
485	4.01
575	4.76
668	5.52
749	6.20
831	6.89

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2