Pile Dynamics Inc

Transducer 727W

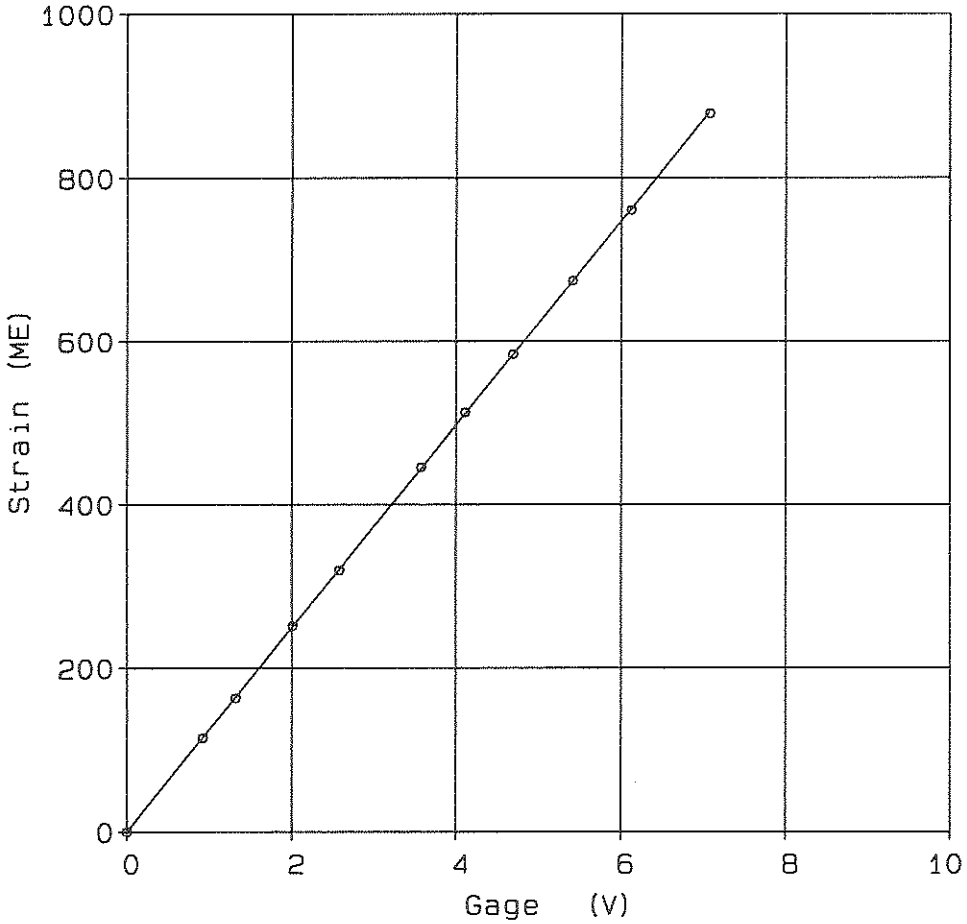

PDA Cal Factor = 124.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 431.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
115	.93
164	1.33
251	2.02
320	2.58
446	3.58
513	4.11
585	4.70
674	5.41
761	6.12
879	7.08

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 20-Jun-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2