Pile Dynamics Inc

Transducer 728W

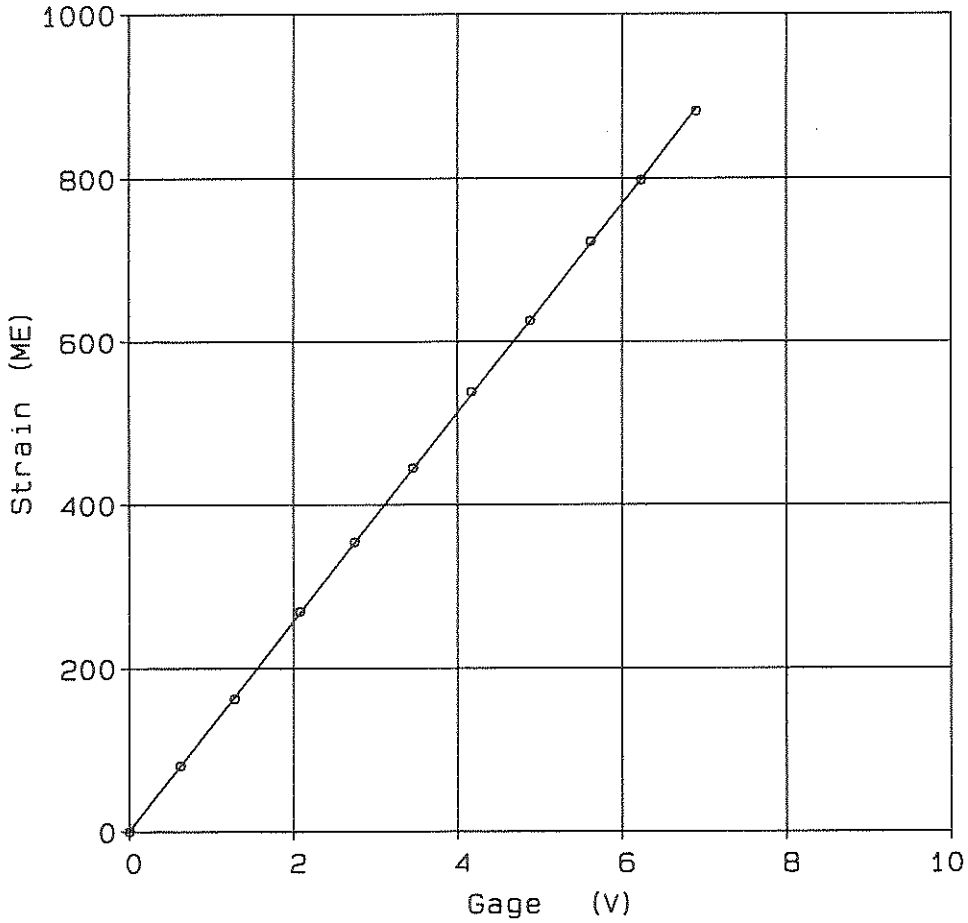

PDA Cal Factor	=	127.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	444.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
81	.62
164	1.28
269	2.09
355	2.75
446	3.47
539	4.17
626	4.88
723	5.63
798	6.23
882	6.91

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2