Pile Dynamics Inc
Transducer 729W

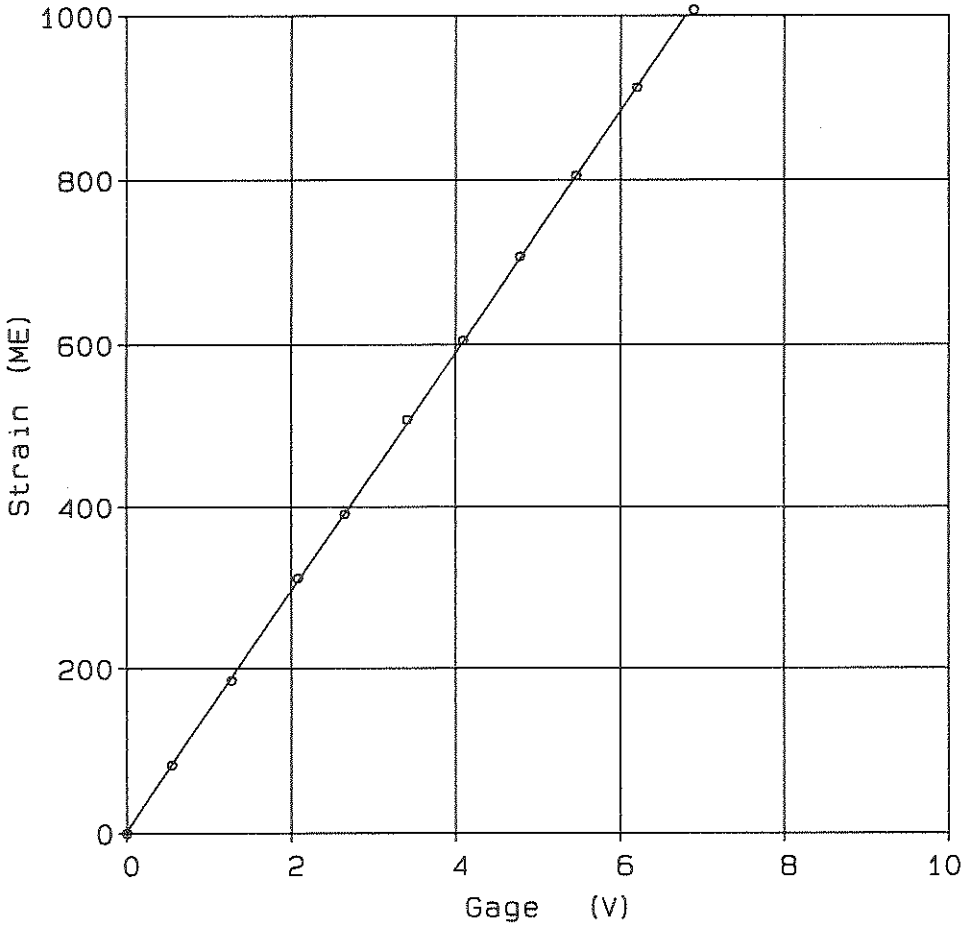

PDA Cal Factor = 146.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 509.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.55
186	1.28
312	2.09
391	2.65
508	3.42
605	4.09
708	4.79
806	5.47
912	6.20
1008	6.89

Calibrated by: J. Dentalff

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2