Pile Dynamics Inc
Transducer 731W

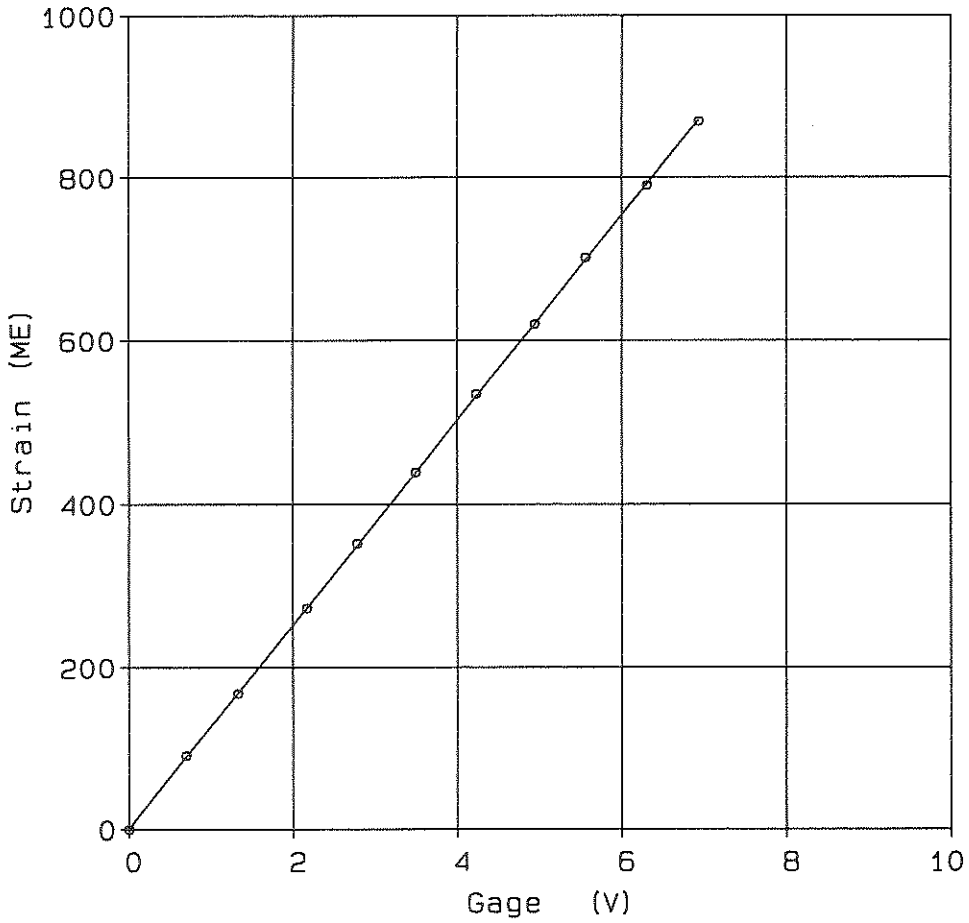

PDA Cal Factor = 125.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 435.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
91	.71
167	1.34
274	2.18
352	2.78
439	3.50
535	4.23
620	4.94
702	5.57
791	6.32
869	6.94

Calibrated by: J. Daintith

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2