Pile Dynamics Inc

Transducer 732W

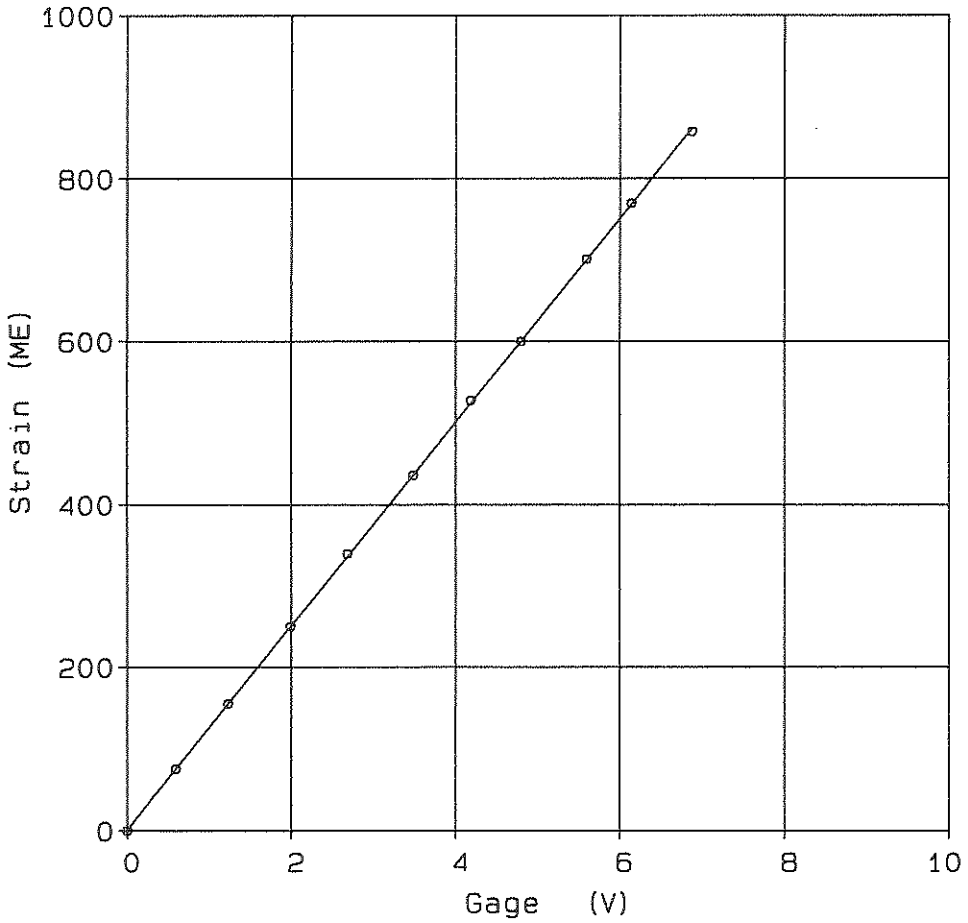

PDA Cal Factor = 124.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 433.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.59
156	1.24
251	2.00
340	2.69
436	3.48
527	4.18
601	4.80
701	5.60
770	6.15
858	6.89

Calibrated by: _____

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2