Pile Dynamics Inc
Transducer 733W

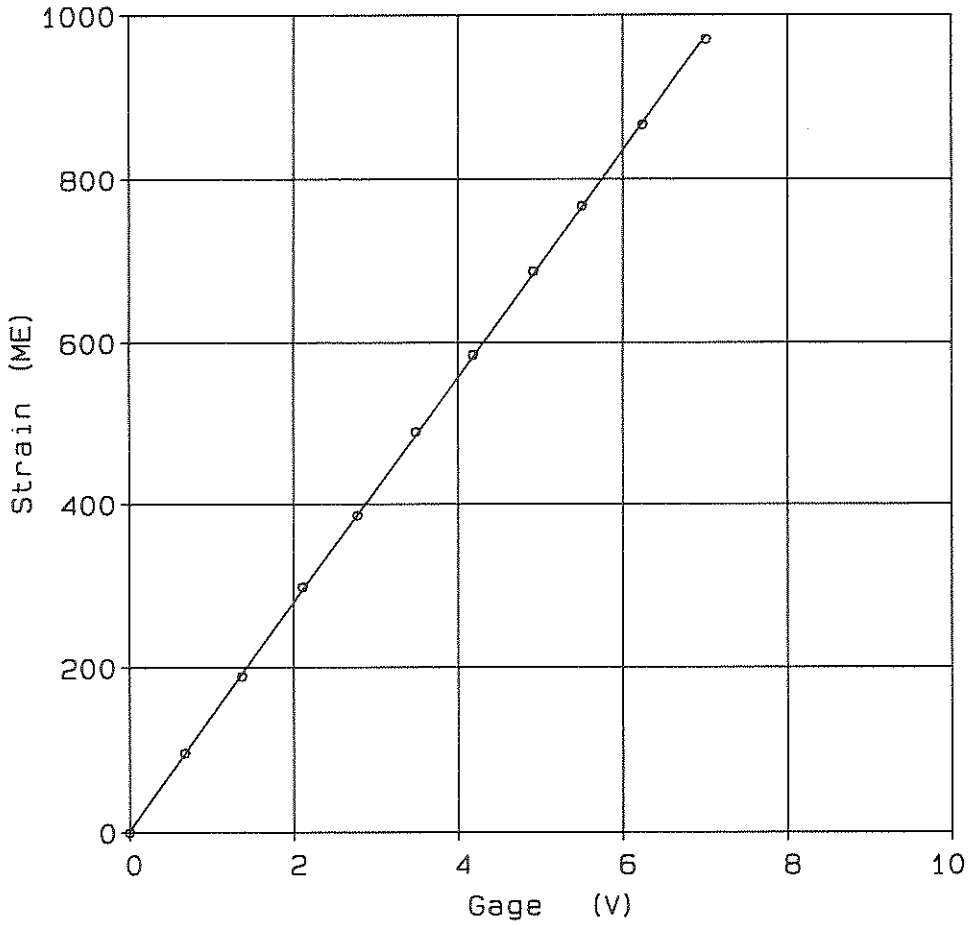

PDA Cal Factor	=	138.8 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	481.8 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.68
189	1.37
298	2.12
386	2.77
491	3.49
585	4.18
688	4.91
768	5.51
866	6.24
971	7.01

Calibrated by: J. Davis

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2