Pile Dynamics Inc

Transducer 734W

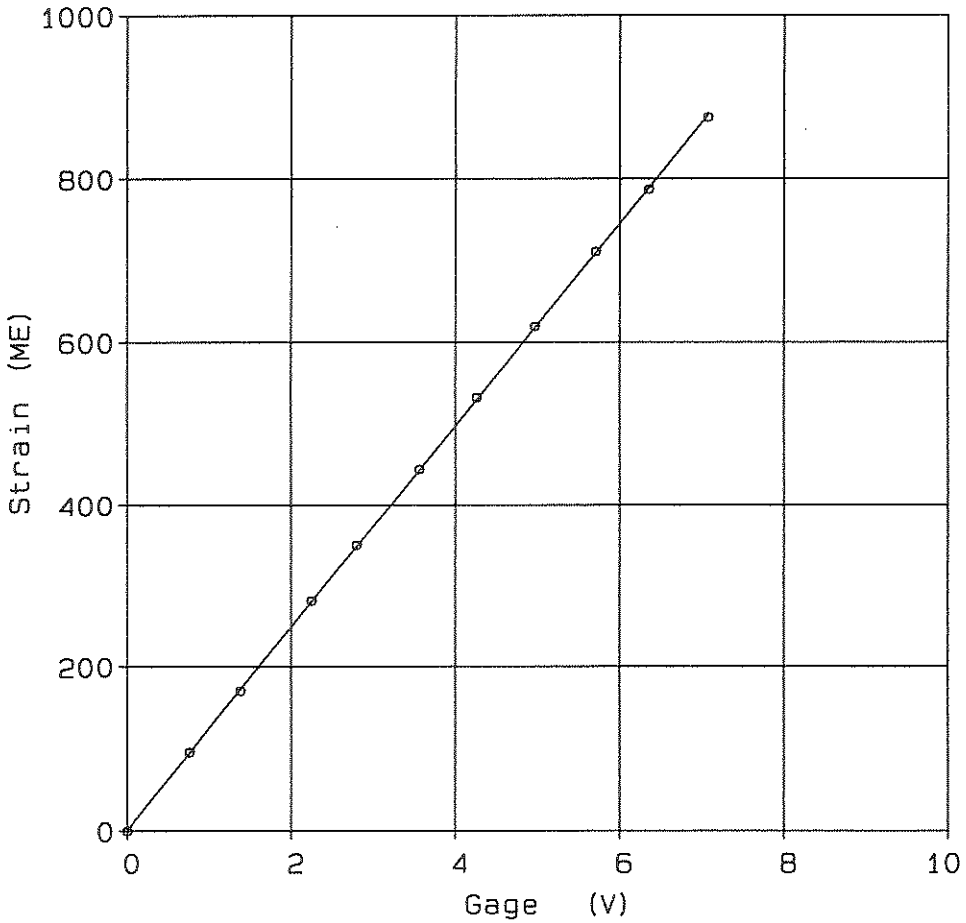

PDA Cal Factor = 123.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 430.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.76
171	1.39
281	2.25
351	2.80
444	3.57
532	4.27
619	4.98
711	5.71
788	6.35
875	7.08

Calibrated by: J. Deistad

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2