Pile Dynamics Inc
Transducer 739W

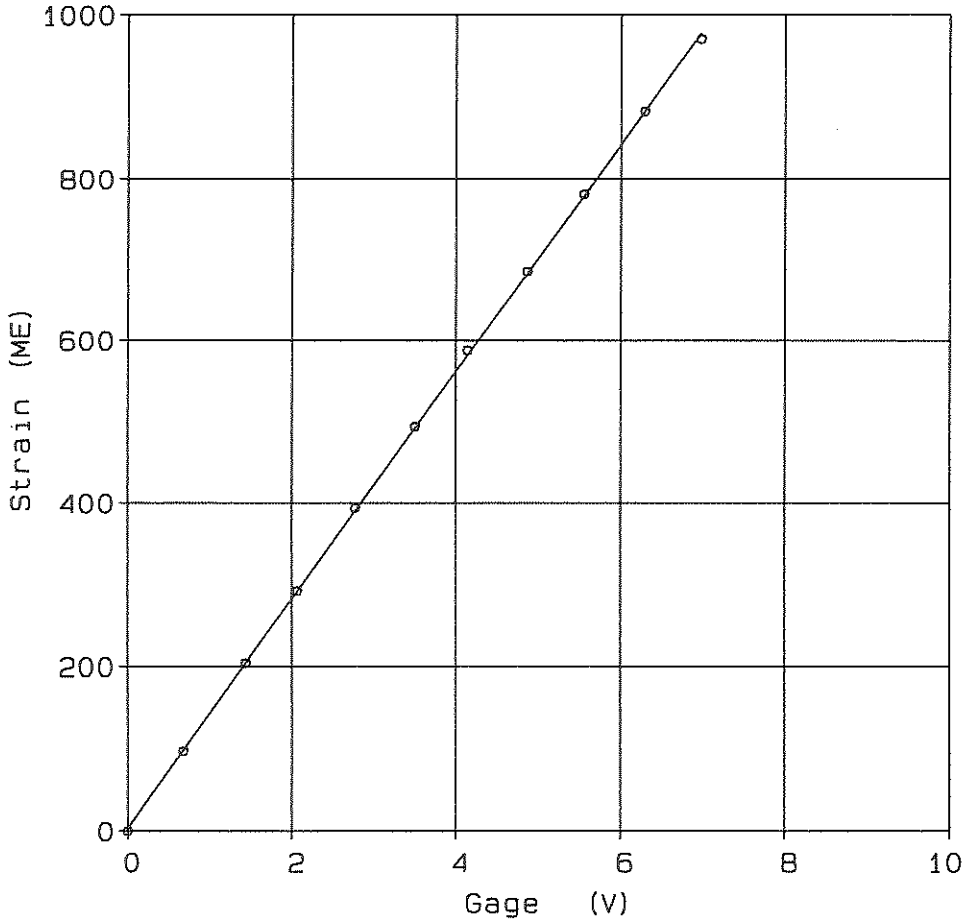

PDA Cal Factor = 139.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 484.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.68
204	1.44
292	2.06
394	2.78
495	3.51
588	4.14
685	4.87
781	5.56
882	6.30
970	6.98

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2