Pile Dynamics, Inc.

Transducer 740W

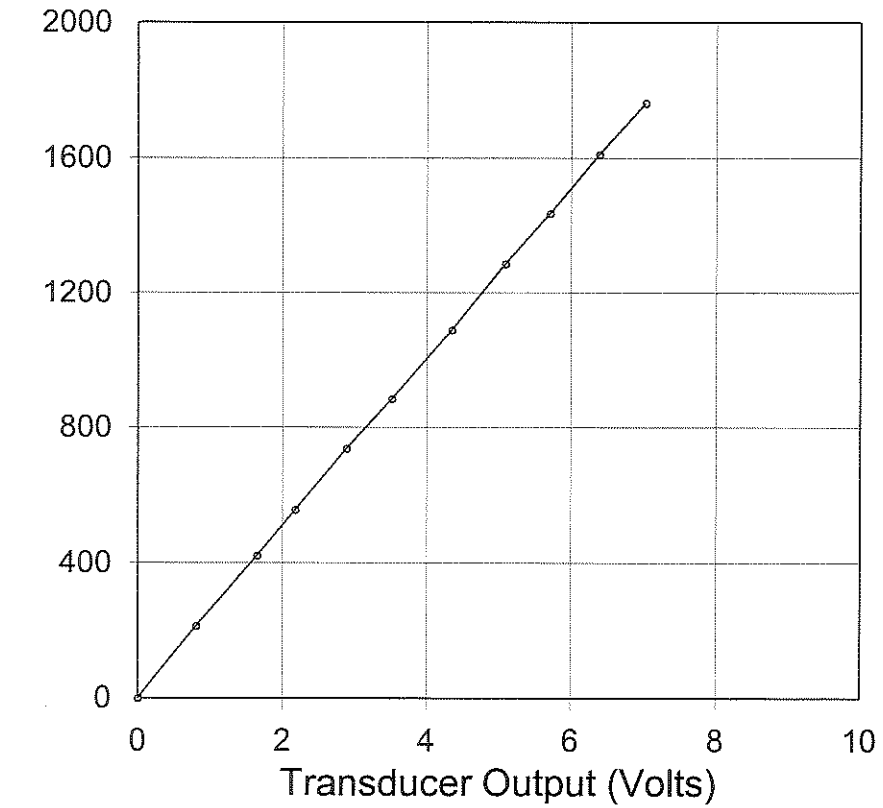

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
214	0.80
421	1.64
554	2.17
736	2.88
883	3.51
1091	4.35
1286	5.09
1436	5.70
1610	6.38
1762	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 435.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 13-Sep-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2