Pile Dynamics, Inc.

Transducer 741W

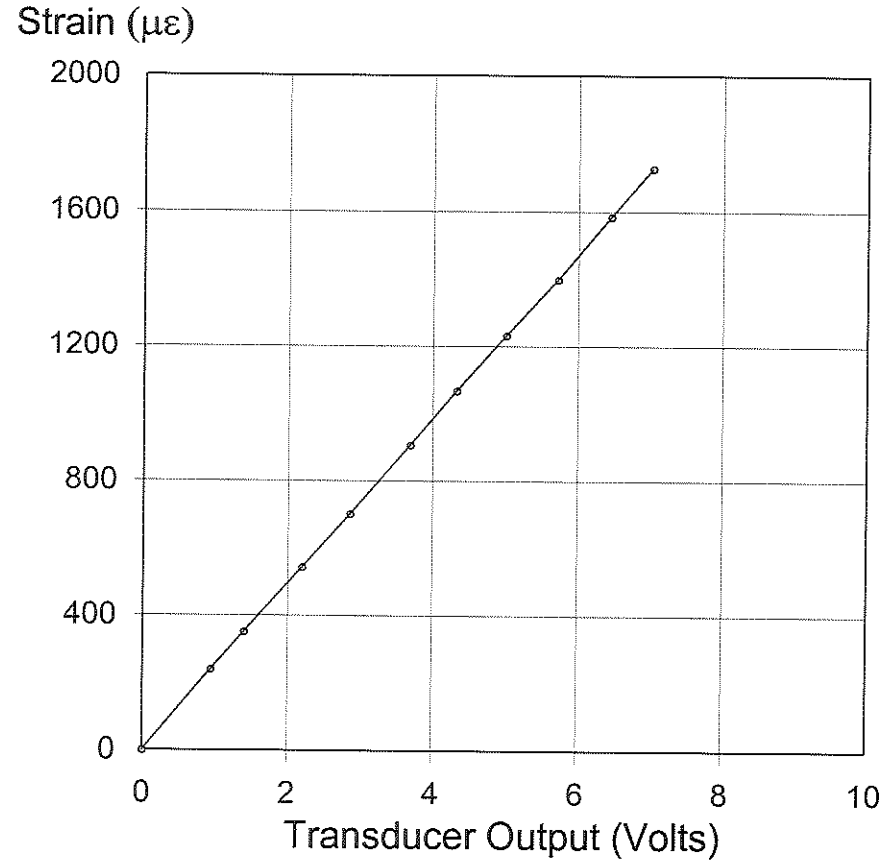

PDA Cal Factor (5.0 V) 122.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
242	0.93
352	1.39
543	2.19
699	2.85
906	3.68
1068	4.32
1233	5.00
1399	5.71
1585	6.44
1728	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 425.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 13-Sep-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2