Pile Dynamics, Inc.

Transducer 742W

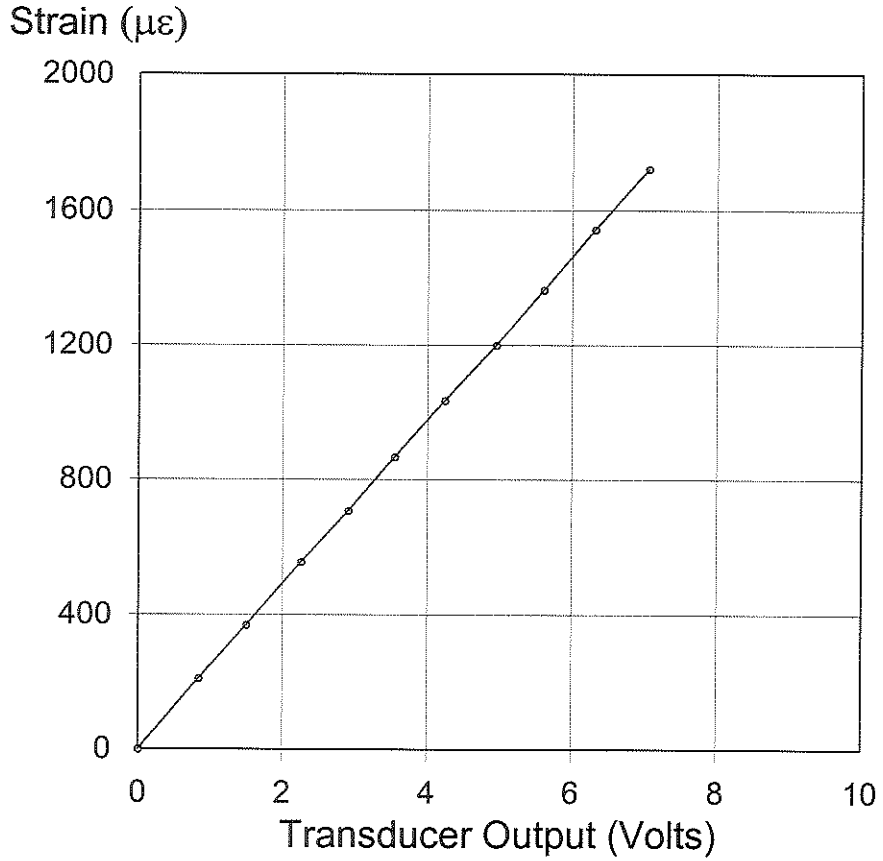

PDA Cal Factor (5.0 V) 121.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
212	0.83
368	1.49
554	2.25
706	2.90
867	3.54
1035	4.23
1201	4.94
1364	5.60
1544	6.31
1721	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 422.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 13-Sep-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2