Pile Dynamics, Inc.

Transducer 746W

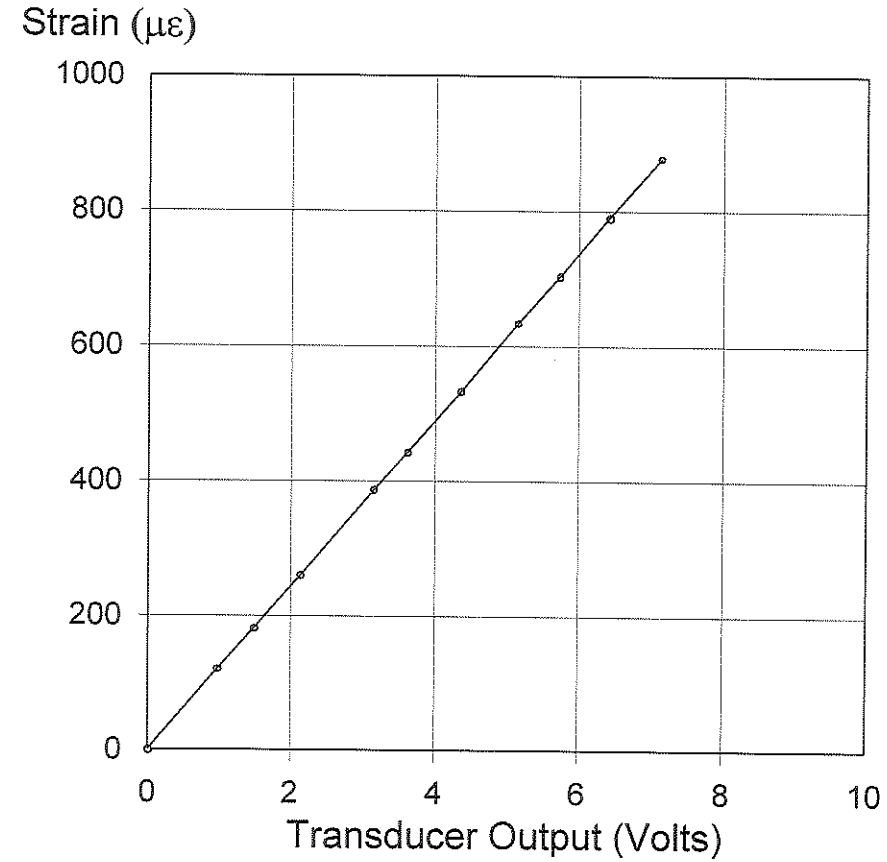

PDA Cal Factor 123.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
121	0.98
181	1.48
260	2.13
386	3.15
443	3.61
533	4.35
634	5.15
704	5.73
790	6.41
878	7.14

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 427.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2