Pile Dynamics, Inc.

Transducer 749W

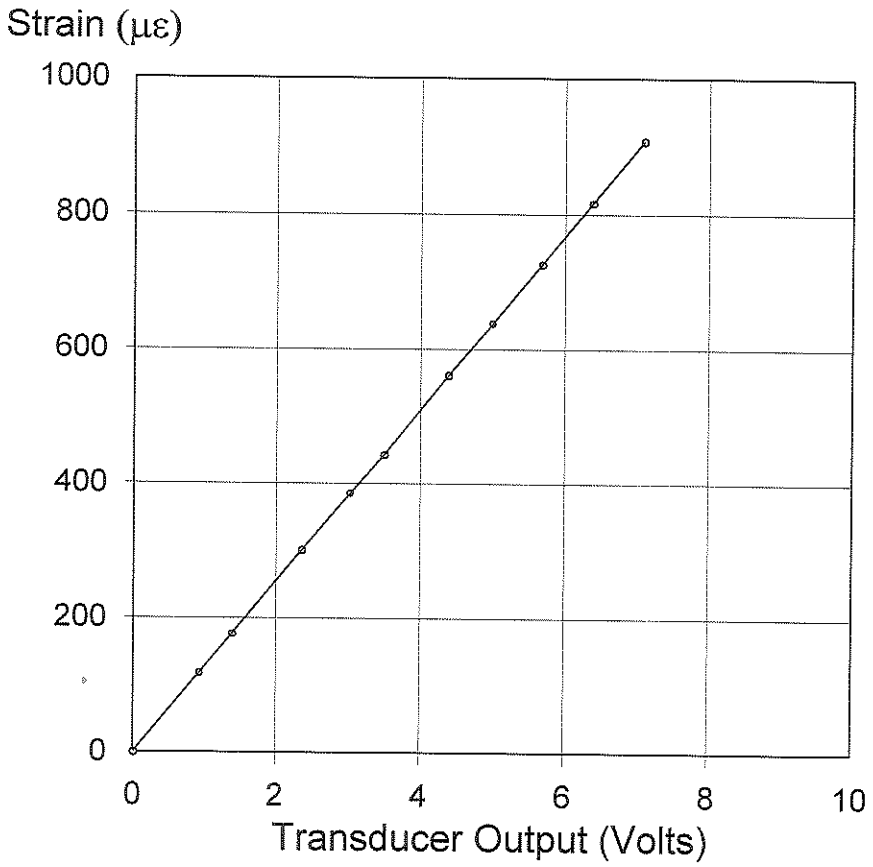

PDA Cal Factor 128.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
119	0.92
176	1.38
301	2.36
385	3.02
442	3.49
561	4.38
638	4.99
725	5.67
817	6.37
909	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 444.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2