Pile Dynamics, Inc.

Transducer 751W

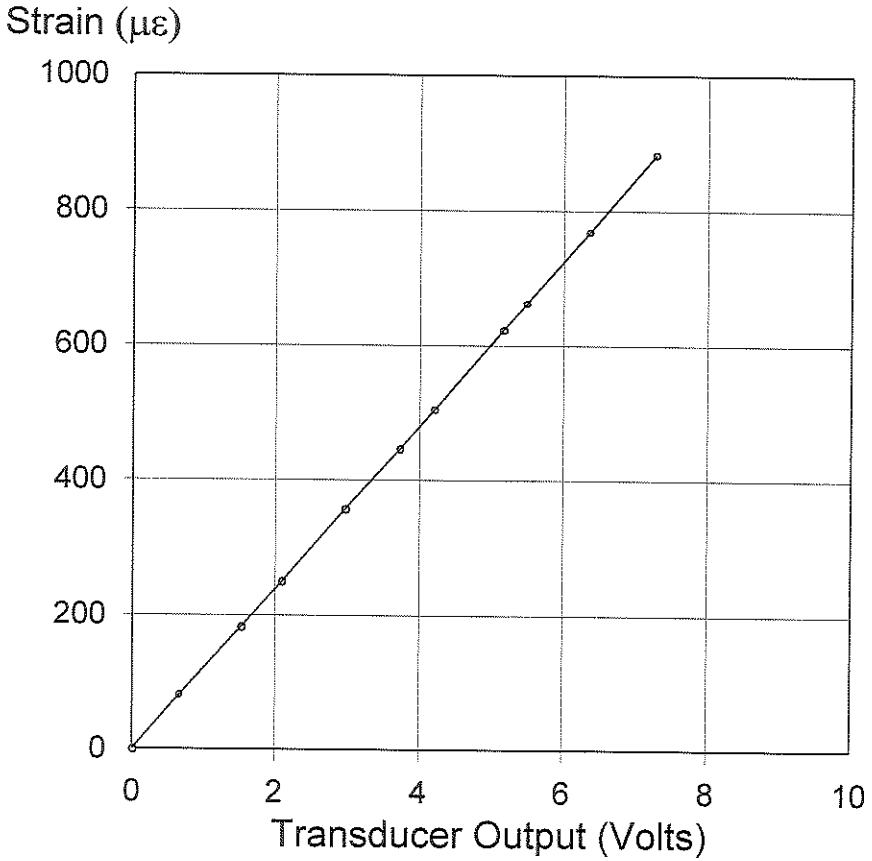

PDA Cal Factor 121.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
81	0.66
183	1.52
250	2.09
356	2.96
447	3.72
505	4.20
623	5.16
661	5.48
768	6.35
883	7.28

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 420.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2