Pile Dynamics, Inc.

Transducer 753W

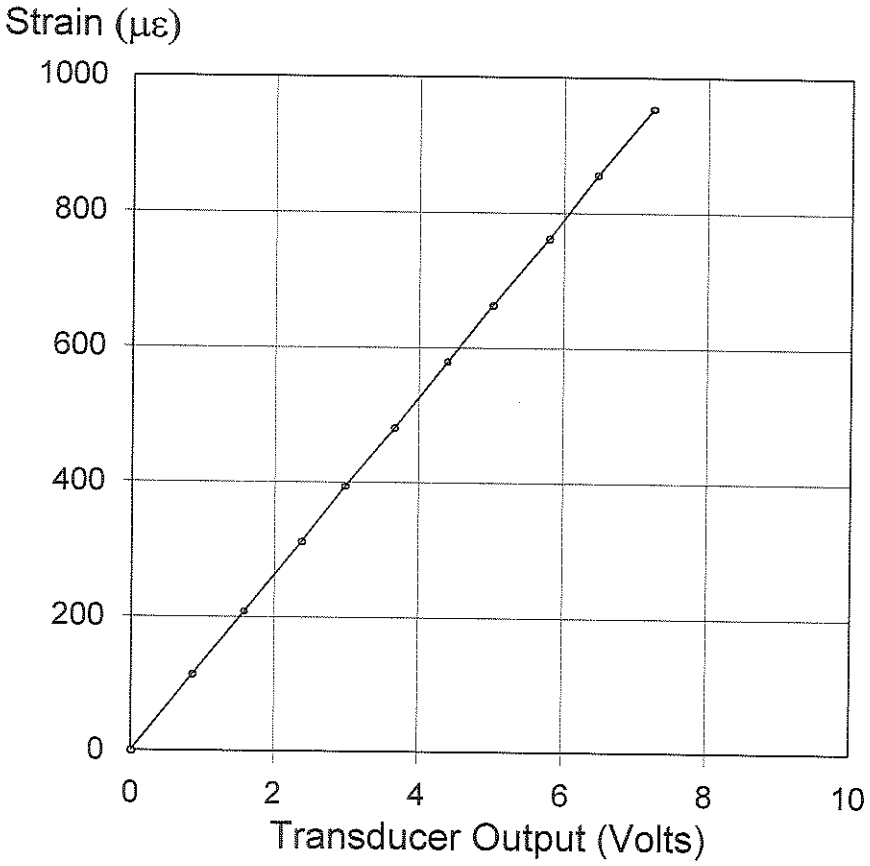

PDA Cal Factor 132.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
114	0.85
208	1.57
312	2.37
394	2.97
481	3.66
580	4.39
663	5.01
763	5.79
856	6.46
954	7.24

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 458.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2