Pile Dynamics, Inc.

Transducer 756W

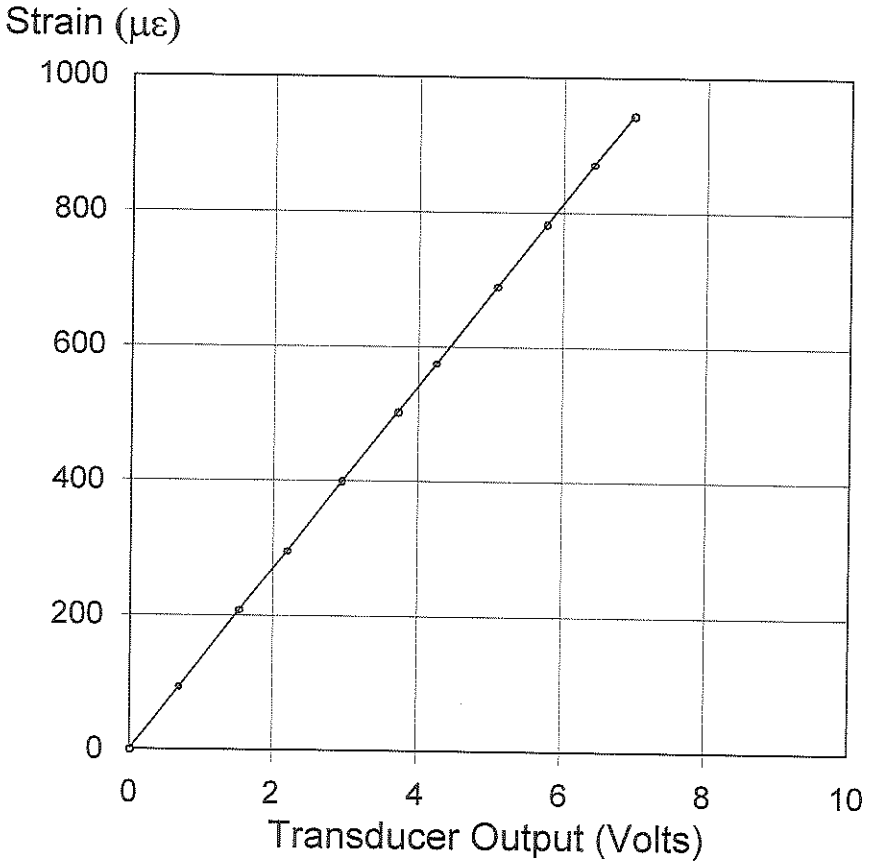

PDA Cal Factor 135.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
94	0.68
207	1.52
295	2.19
400	2.95
503	3.71
574	4.24
689	5.07
783	5.76
871	6.41
945	6.97

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 471.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2