Pile Dynamics, Inc.

Transducer 758W

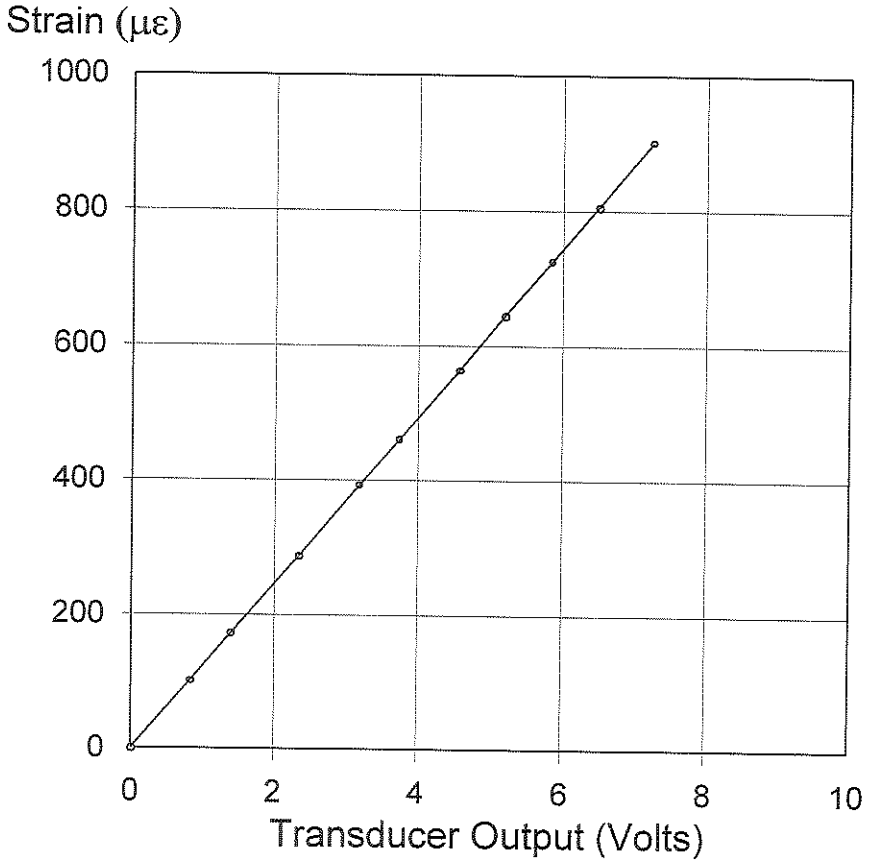

PDA Cal Factor 124.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
102	0.82
173	1.39
287	2.33
392	3.18
460	3.73
563	4.56
644	5.19
725	5.84
806	6.49
902	7.24

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 431.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2