Pile Dynamics, Inc.

Transducer 759W

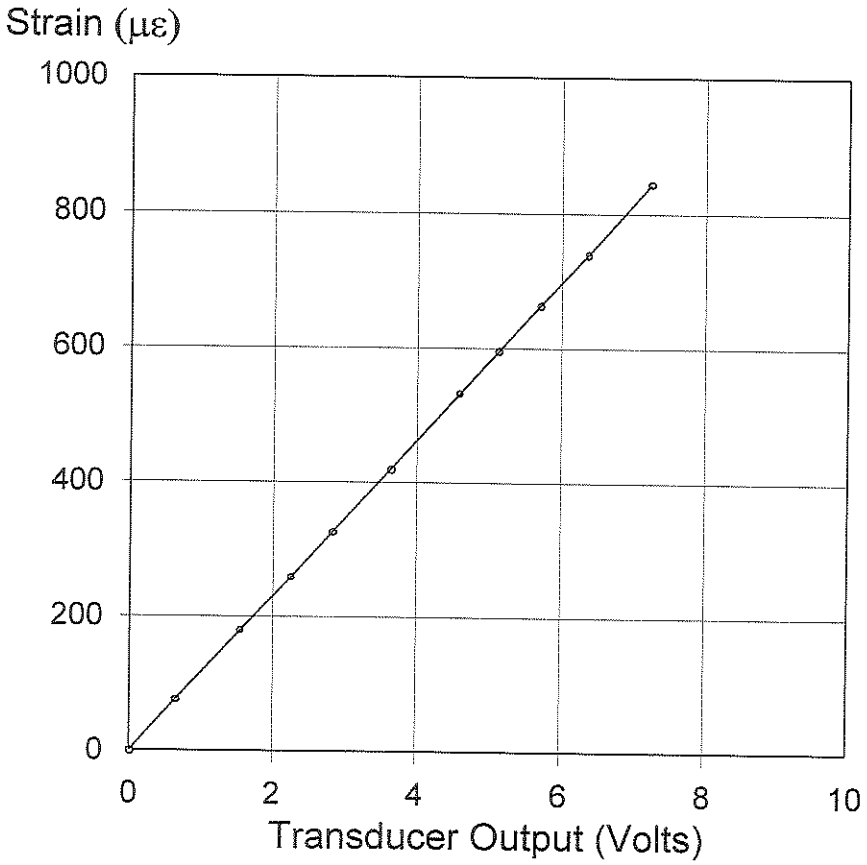

PDA Cal Factor 116.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
76	0.64
179	1.54
258	2.24
326	2.82
419	3.63
532	4.59
595	5.13
664	5.70
740	6.36
843	7.23

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 404.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2