Pile Dynamics, Inc.

Transducer 760W

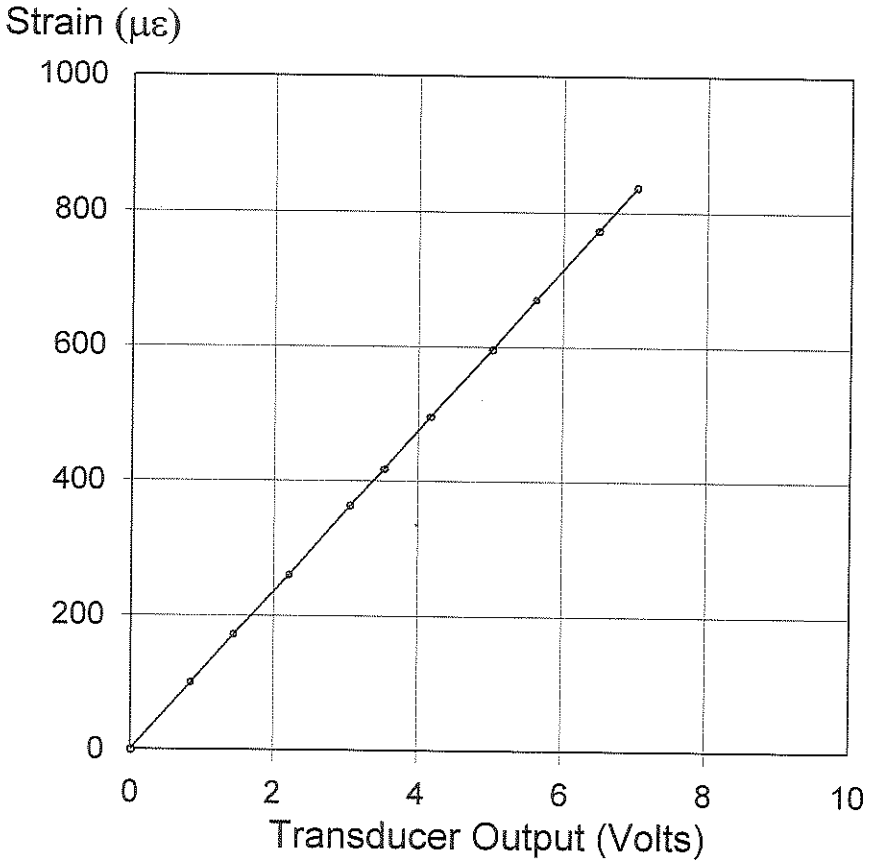

PDA Cal Factor 119.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
100	0.84
171	1.44
261	2.21
363	3.05
417	3.52
495	4.16
596	5.01
671	5.62
773	6.48
837	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 414.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 22-Dec-2004

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2