Pile Dynamics, Inc.

Transducer 768W

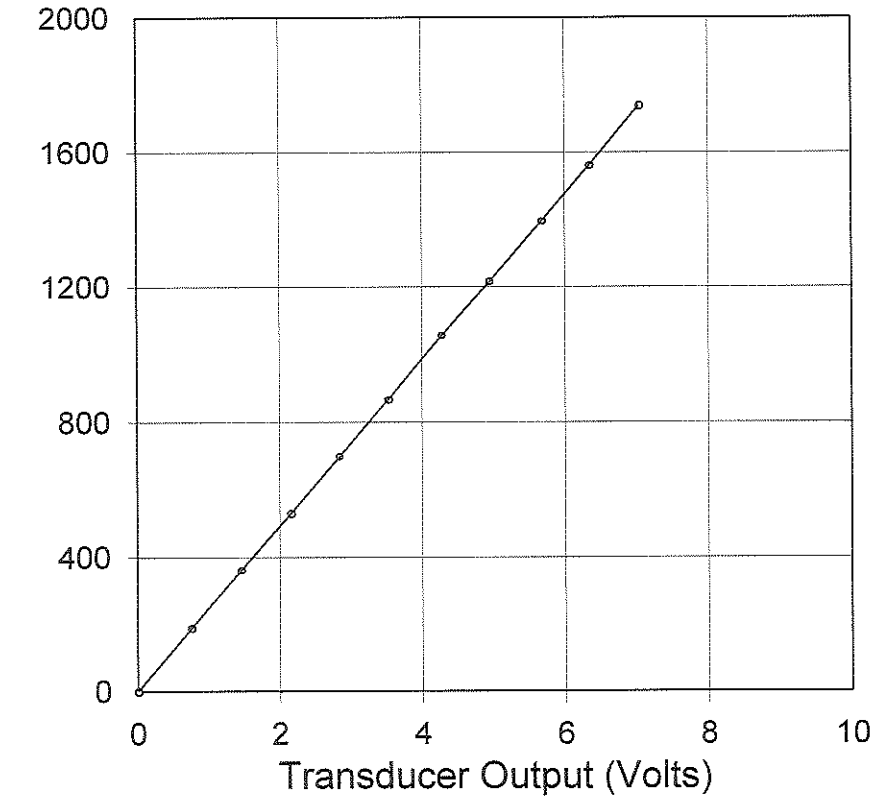

PDA Cal Factor (5.0 V) 123.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
190	0.75
361	1.45
529	2.15
699	2.84
866	3.52
1056	4.27
1216	4.94
1395	5.67
1562	6.34
1739	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 427.3με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 13-Oct-2005

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2