Pile Dynamics, Inc.

Transducer 770W

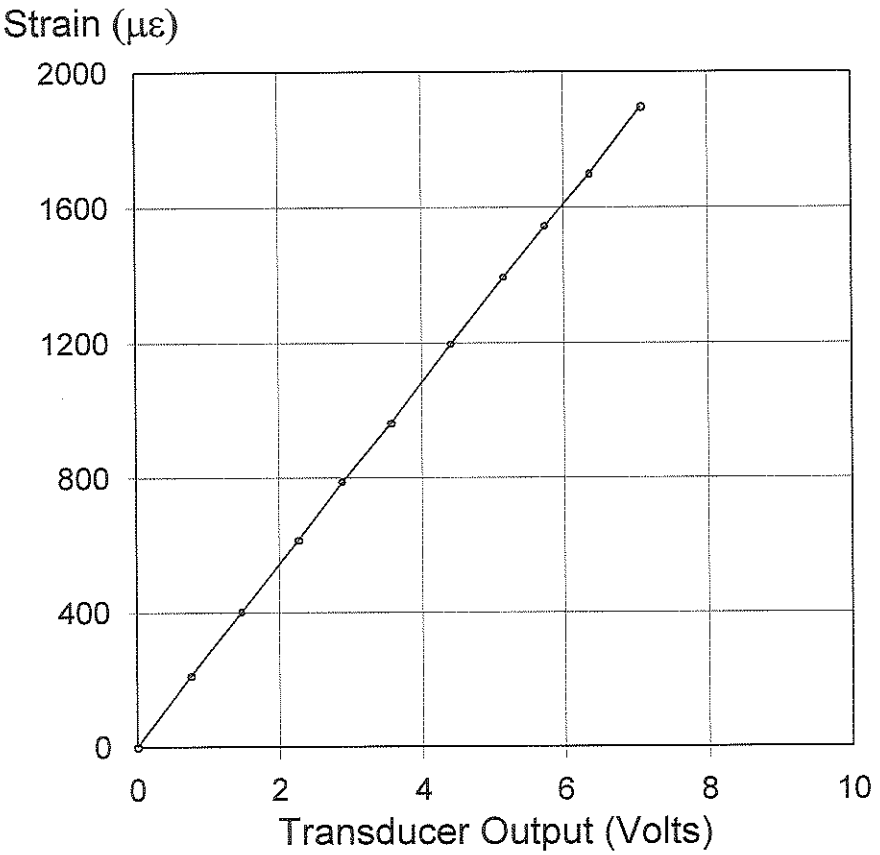

PDA Cal Factor (5.0 V) 133.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
210	0.75
401	1.47
613	2.26
786	2.88
963	3.56
1196	4.41
1393	5.14
1545	5.73
1700	6.36
1897	7.08

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 464.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 27-Oct-2005

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2