Pile Dynamics, Inc.

Transducer 773W

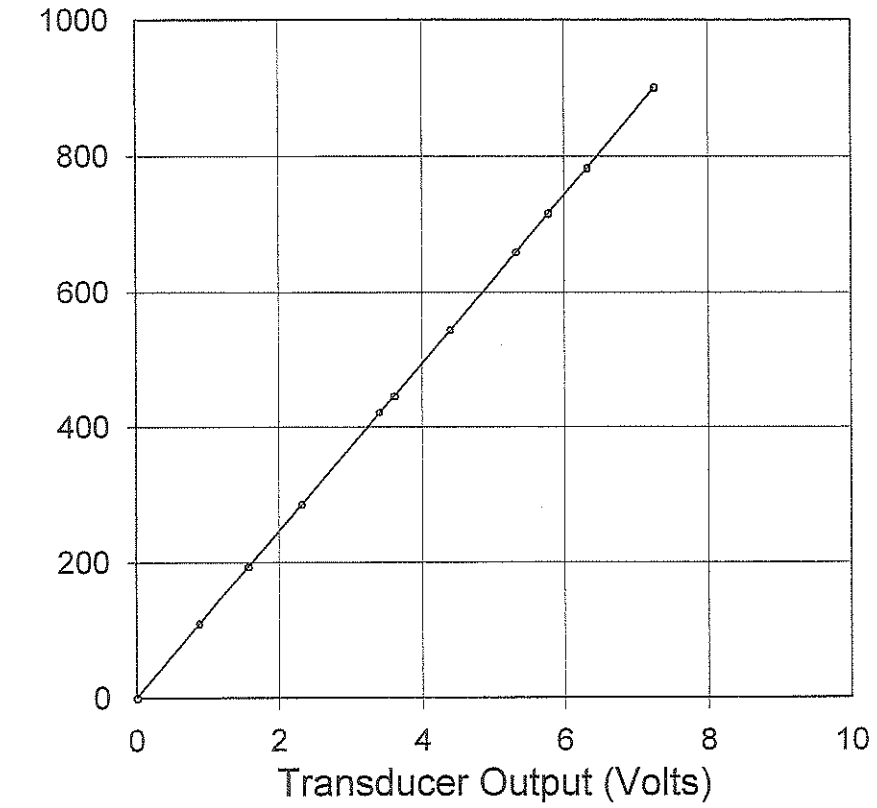

PDA Cal Factor 124.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
111	0.88
193	1.57
284	2.31
421	3.40
445	3.60
543	4.39
659	5.31
716	5.77
783	6.32
901	7.26

Shunt (60.4 KΩ) 5.0 V

General Factor 430.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 02-Aug-2005

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2