Pile Dynamics, Inc.

Transducer 793W

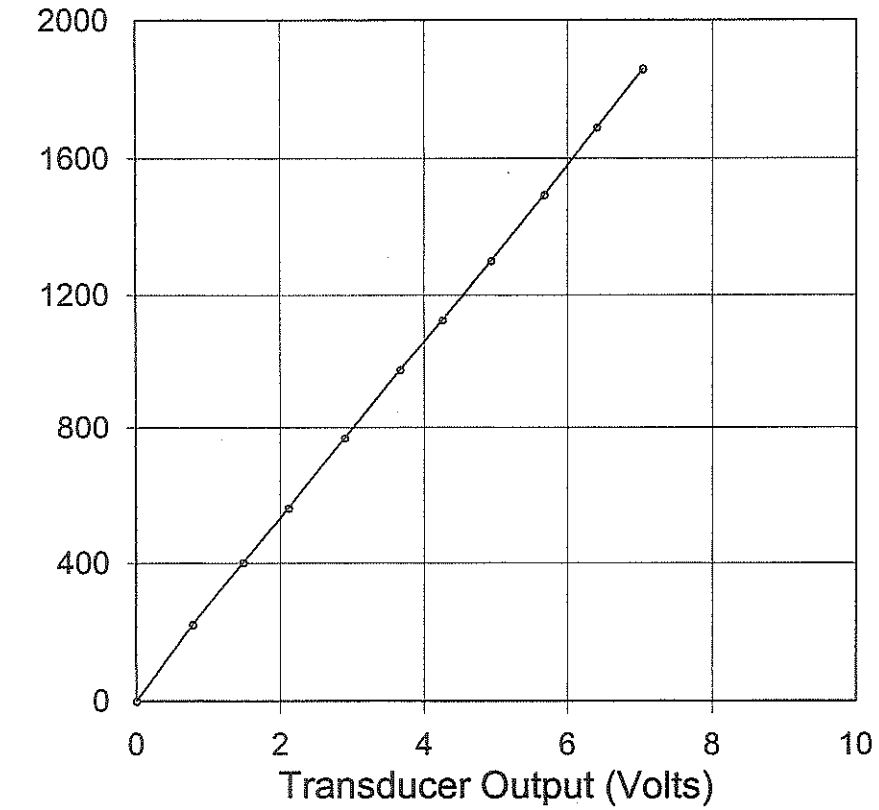

PDA Cal Factor (5.0 V) 131.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
221	0.78
401	1.48
560	2.11
768	2.89
978	3.66
1127	4.25
1300	4.93
1492	5.67
1692	6.40
1861	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 456.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 23-May-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2