Pile Dynamics, Inc.

Transducer 794W

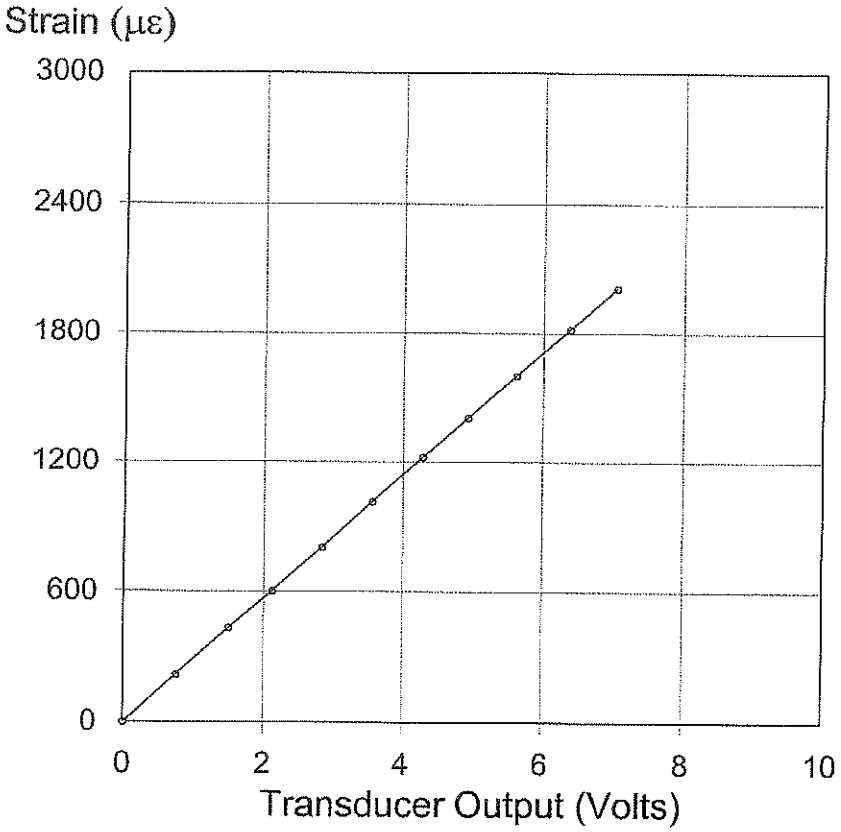

PDA Cal Factor (5.0 V) 142.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
219	0.74
433	1.49
602	2.12
805	2.83
1015	3.55
1222	4.28
1403	4.92
1601	5.61
1820	6.37
2012	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 495.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3