Pile Dynamics, Inc.

Transducer 796W

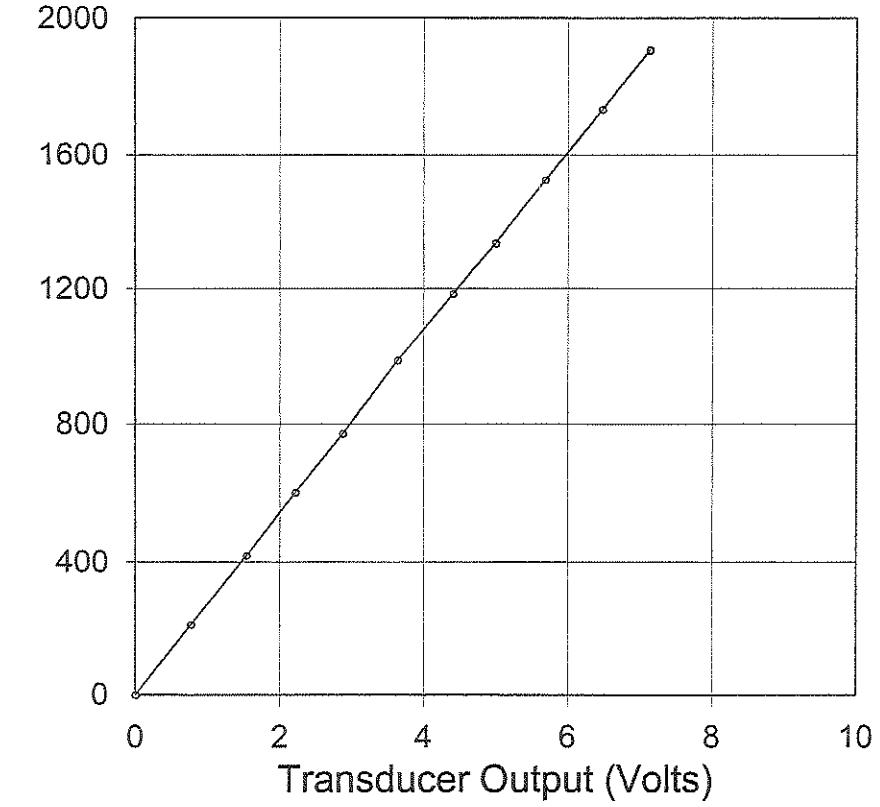

PDA Cal Factor (5.0 V) 133.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
213	0.76
420	1.53
601	2.21
772	2.87
985	3.63
1185	4.40
1336	4.99
1526	5.68
1737	6.47
1911	7.13

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 463.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 25-Jul-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2